


HP60A-15KW-GD-QBH

高功率探测器的激光功率测量高达 15000 W。

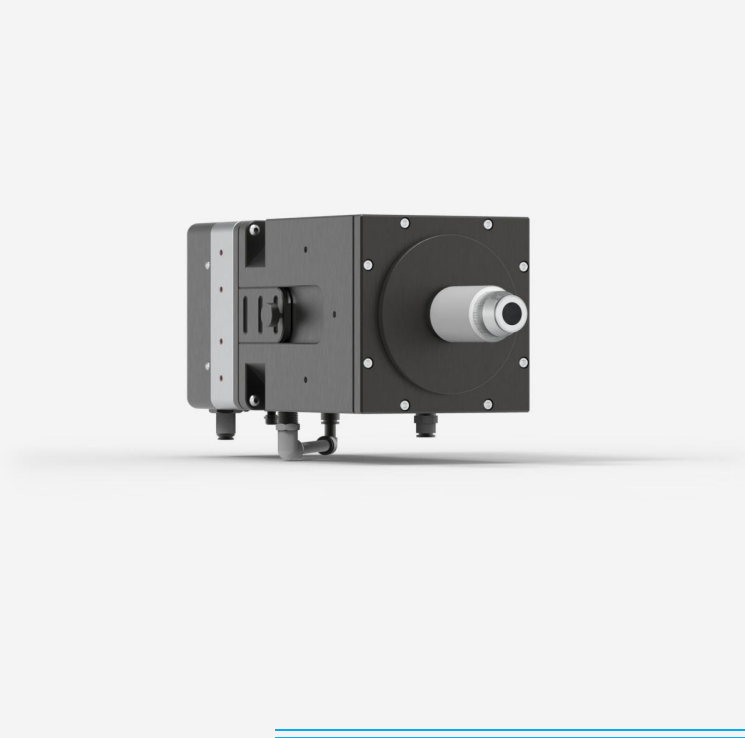

产品系列主要特性

- 大功率**
- 稳定读数**
对水冷温度的变化不太敏感
- 大孔径**
我们的标准 HP 型号 (4KW、12KW、15KW 和 30KW) 具有高达 280 mm 有效孔径
- 提供 YAG 和 CO₂ 校准**
所有 HP 型号均可在 YAG 和 CO₂ 波长下校准, 校准不确定度为 +/- 5%
- 可用USB直接与电脑相连**
每个镜头均带有一个 DB15 接头 (用于与 Genetec-EO 显示器连接) 和一个用于与电脑直接连接的 USB2.0 输出接头

规格

测量能力	
最大平均功率 (连续)	15000 W
最小平均功率 ¹	500 W
噪声等效功率 ²	15 W
光谱范围	0.8 - 12 μm
典型升起时间	15 s
典型功率敏感度	0.13 mV/W
功率校准不确定性	±5 %
重复性	±2 %
背面反射	1 - 2 %
线性与功率	±2 %
线性对比光速直径	±2.5 %
线性对比光速位置 ³	±4 %
1. 请致电您的 Gentec-EO 代表, 了解较低功率。 2. 标称值。实际值取决于测量系统中的电气噪音。 3. 对于孔径面积 20% 的光束尺寸, 移动穿过 80% 的孔径面积。	
需水量	
要求冷却流 ¹	(8 - 10) LPM < ±1 LPM/min
温度范围	15 - 25 °C
温度变化率	< ±3°C/min
最大水压	413 kPa (60 psi)
1. 联系 Gentec-EO, 选择洁净的去离子水冷却模块。	
损坏阈	
最大平均功率密度 ¹	80 kW/cm ²
1. 1064 nm, 1.07-1.08 μm 和 10.6 μm, 500 W CW。May vary with wavelength and average power.	
控制器和图形用户界面 (GUI) 规格	

数据显示	实时、示波器、指针、平均值、直方图和统计数据
模拟输出 ¹	0-2 Volts
串行命令方式	USB
外部电源 ²	使用 USB 或 Gentec-EO 显示屏与计算机界面
显示屏类型	无
1. 可根据要求提供 12 V 最大输出信号。 2. 如果 HP 与 DB-15 延伸缆线搭配使用, 则需要 USB 电源适配器。	
物理特性	
冷却	水
孔径	70 mm
吸收器	GD
尺寸	153H x 153W x 386D mm
重量	16 kg
订购信息	
HP60A-15KW-GD-QBH	205558

规格如有更改, 恕不另行通知。有关完整规格, 请参阅用户手册。

对这个产品感兴趣吗？

获得报价

通过 gentec-eo.cn/contact-us 找到您的本地销售代表