



GUIDE DE L'UTILISATEUR

S-LINK | Mesureur de puissance & d'énergie avec interface PC

GARANTIE

Le S-Link, mesureur de puissance et d'énergie avec interface PC de Gentec-EO est garanti contre tout vice de fabrication et de main d'œuvre pour une durée d'un an (à compter de la date d'expédition), lorsqu'il est utilisé dans des conditions de fonctionnement normales. La garantie ne couvre pas les dommages liés à une mauvaise utilisation ou à une pile qui fuit.

Gentec-EO Inc. réparera ou remplacera, à sa discrétion, tout S-Link qui présente un défaut pendant la période de garantie, excepté dans le cas d'une mauvaise utilisation du produit.

La garantie est annulée si une personne non autorisée tente de modifier ou de réparer le produit.

Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages consécutifs, de quelque nature que ce soit.

En cas de mauvais fonctionnement, communiquez avec votre distributeur local Gentec-EO ou avec le bureau Gentec-EO Inc. le plus proche, afin d'obtenir un numéro d'autorisation de retour. Le matériel doit être retourné à :

Gentec Electro-Optics, Inc.
445, St-Jean-Baptiste, bureau 160
Québec, QC
Canada G2E 5N7

Téléphone : 418 651-8003
Télécopieur : 418 651-1174
Courriel : service@gentec-eo.com

Site Web : www.gentec-eo.com

RÉCLAMATIONS

Pour bénéficier d'un service sous garantie, communiquez avec votre représentant Gentec-EO le plus proche, ou envoyez le produit, accompagné d'une description du problème, avec l'assurance et le transport prépayés, au représentant Gentec-EO le plus proche. Gentec-EO Inc. n'assume aucune responsabilité en cas de dommage causé pendant le transport. Gentec-EO Inc. se réserve le droit de réparer ou de remplacer gratuitement le produit défectueux, ou de vous rembourser le prix d'achat. Toutefois, si Gentec-EO Inc. détermine que la défectuosité a été causée par une mauvaise utilisation, une modification, un accident ou des conditions de fonctionnement ou de manipulation anormales, vous serez facturé pour la réparation, et le produit réparé vous sera retourné, transport prépayé.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Ne pas utiliser le S-Link si le dispositif ou le détecteur semble endommagé, ou si vous soupçonnez que le S-Link ne fonctionne pas correctement.

Une installation appropriée doit être effectuée pour les détecteurs refroidis à l'eau ou par ventilateur. Se reporter aux instructions spécifiques pour de plus amples renseignements. L'utilisateur doit attendre quelque temps avant de manipuler ces détecteurs après leur mise sous tension. Les surfaces des détecteurs deviennent très chaudes et posent un risque de blessure en cas de contact avant qu'elles n'aient refroidi.

Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites pour un appareil numérique de classe A, conformément à l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont destinées à fournir une protection raisonnable contre une interférence nuisible, lorsque l'équipement est utilisé dans un environnement résidentiel. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie par fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer une interférence nuisible pour les communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil hors tension puis sous tension, nous vous suggérons de corriger ce problème en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Modifier l'orientation ou l'emplacement de l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'appareil sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Demander conseil à un fournisseur ou technicien spécialisé en radio/télévision.

Avertissement : Tout changement ou modification n'ayant pas été expressément approuvé par écrit par Gentec-EO Inc. pourrait annuler le droit de l'utilisateur de faire fonctionner cet équipement.

SYMBOLES

Les symboles internationaux suivants sont utilisés dans ce guide :



Se reporter au guide pour obtenir de l'information spécifique sur les Avertissements et les Mises en garde, dans le but d'éviter d'endommager le produit.



C.C., courant continu

TABLE DES MATIÈRES.

1. LE MESUREUR DE PUISSANCE / D'ÉNERGIE LASER À DEUX CANAUX S-LINK	
GARANTIE.....	2
RÉCLAMATIONS.....	2
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ.....	3
SYMBOLES.....	3
LISTE DES ILLUSTRATIONS.....	5
1 LE MESUREUR DE PUISSANCE / D'ÉNERGIE LASER À DEUX CANAUX S-LINK	6
1.1 INTRODUCTION.....	6
1.2 CE QUI EST INCLUS AVEC VOTRE S-LINK.....	7
1.3 SPÉCIFICATIONS.....	8
1.4 DESCRIPTIONS DES CONNECTEURS.....	10
POUR COMMENCER	12
1.5 PROCÉDURE DE MESURES DE PUISSANCE ET D'ÉNERGIE RAPIDE.....	12
1.6 INTERFACE UTILISATEUR.....	14
1.6.1 <i>Démarrez le logiciel PC S-Link sur l'ordinateur. Cliquez sur Start / Programs /GENTEC-EO/ PC S-Link.</i>	14
1.6.2 <i>Établir une connexion avec le S-Link</i>	14
1.6.3 <i>L'affichage en temps réel</i>	15
1.6.4 <i>La fenêtre de l'état (Status Window)</i>	16
1.6.5 <i>Sélectionner le canal à afficher</i>	16
1.6.6 <i>Ajuster l'affichage des fenêtres</i>	17
1.6.7 <i>Le graphique</i>	18
1.6.8 <i>L'option du mode graphique après le chargement d'un fichier</i>	19
1.6.9 <i>Redémarrer le graphique en temps réel, les statistiques et l'histogramme</i>	20
1.6.10 <i>Faire une acquisition</i>	21
1.6.11 <i>Mettre en pause les statistiques et le graphique en temps réel</i>	21
1.6.12 <i>Faire une remise à zéro</i>	21
1.6.13 <i>Mode rapport (Ratio)</i>	22
1.6.14 <i>Détecter des impulsions laser manquantes.</i>	23
1.6.15 <i>Ordinateur recommandé</i>	25
INSTALLATION ET COMMUNICATION	27
1.7 INSTALLATION.....	27
1.7.1 <i>Installation des pilotes USB pour Windows™</i> :.....	27
1.8 CONFIGURATION DE LA COMMUNICATION VERS LE S-LINK.....	28
1.8.1 <i>Vérification du port COM</i>	28
1.8.2 <i>Réduire le réglage du temps de latence</i>	28
1.8.3 <i>Branchement du PC S-Link au S-Link</i>	28
1.8.3.1 <i>Téléchargement du fichier PC S-Link et le faire fonctionner</i>	28
1.8.3.2 <i>Installation</i>	28
1.8.4 <i>Faire fonctionner le PC S-Link</i>	29
1.8.4.1 <i>Démarrer PC S-Link</i>	29
1.8.4.2 <i>S'assurer que le bon port de communication est sélectionné</i>	29
1.8.4.3 <i>Sortir du programme PC S-Link</i>	29
1.8.5 <i>Branchement au S-Link</i>	29
1.8.6 <i>Pour mettre les commandes en écho</i>	30
1.8.7 <i>Testez la connexion</i>	30
1.9 COMMANDES SÉRIES DU S-LINK.....	30

2	ENTRETIEN.....	37
2.1	INSTALLATION USB POUR LE S-LINK.....	37
2.2	MISE À NIVEAU GRATUITE DU LOGICIEL	37
3	PROCÉDURE D'INSTALLATION DE L'ETHERNET	38
3.1	INSTALLER CES FICHIERS À PARTIR DU CD	38
3.2	CRÉER UN PORT COM.....	38
3.3	ACHEMINEZ L'ADRESSE IP AU PORT COM.	40
3.4	CONFIGURER UNE CONNEXION RÉSEAU DIRECTE ENTRE UN ORDINATEUR À ENVIRONNEMENT WINDOWS ET UN S-LINK	41
3.4.1	<i>Configurer le protocole TCP-IP sur votre ordinateur.</i>	41
3.4.2	<i>Configurer l'adresse IP dans S-Link</i>	44
3.4.3	<i>Régler les valeurs par défaut de l'Ethernet dans le S-Link</i>	46
4	DÉPANNAGE.....	50
	DÉCLARATION DE CONFORMITÉ.....	51
5	ANNEXE A.....	52
5.1	PROCÉDURE D'ÉTALONNAGE DE L'ATTÉNUATEUR/DIFFUSEUR	52
6	ANNEXE B.....	54
6.1	PROCÉDURE DE RECYCLAGE ET DE TRI	54
6.2	TRI :.....	54
6.3	PROCÉDURE DE DÉMONTAGE :	54
7	ANNEXE C.....	55
7.1	PROCÉDURE POUR RÉPARER LE PORT COM.....	55
8	ANNEXE D.....	58
8.1	S-LINK-2 DESCRIPTION DU MODE BINAIRE	58
8.1.1	<i>DESCRIPTION</i>	58
8.1.2	<i>CODIFICATION</i>	59

LISTE DES ILLUSTRATIONS

ILLUSTRATION 1.1	INTERFACE UTILISATEUR DU PC S-LINK	6
ILLUSTRATION 1-2	CONNECTEURS DU S-LINK-ETHERNET	10

1 LE MESUREUR DE PUISSANCE / D'ÉNERGIE LASER À DEUX CANAUX S-LINK



1.1 Introduction

Pour obtenir une performance optimale du S-Link et du PC S-Link, nous vous recommandons de lire attentivement ce guide.

Le logiciel PC S-Link transforme votre écran d'ordinateur en un grand écran S-Link, vous permettant ainsi de contrôler et de voir l'information à distance, et de transférer les données vers un ordinateur dans le but d'obtenir une analyse détaillée des données.

Le S-Link est un mesureur de puissance et d'énergie fondé sur un microprocesseur qui utilise la technologie la plus récente pour offrir une multitude d'options faciles à utiliser. Le S-LINK est un mesureur de puissance et d'énergie complet qui offre une analyse statistique de vos mesures.

La version 5 et ultérieures des détecteurs ne requièrent pas de saisir manuellement les paramètres du capteur, lors de la connexion à PC SLINK. L'intérieur du S-LINK est déjà configuré pour recevoir toutes les têtes de wattmètre et de joulemètre de haute puissance de Gentec-EO, grâce aux versions 5 et 6 de la tête de connecteur de type DB-15. Le S-Link accepte le QE-xx-x-MT ou un XLE-4.

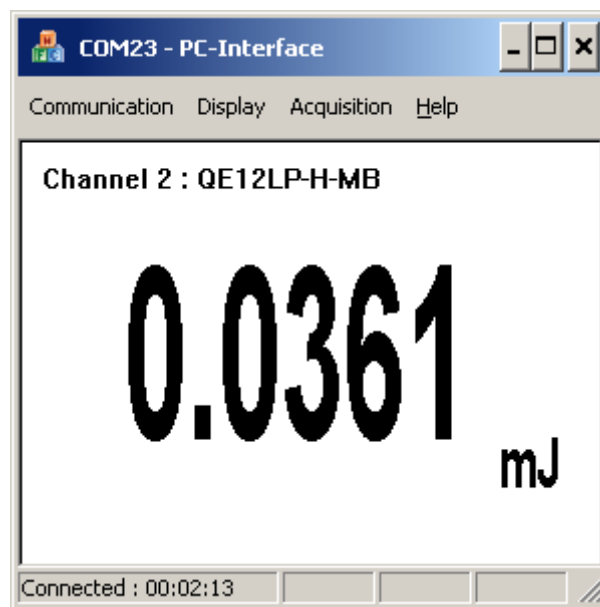


Illustration 1.1 Interface utilisateur du PC S-Link

Déballage

Chaque S-Link de Gentec-EO est entièrement testé et étalonné avant l'expédition.

Vérifiez visuellement chaque S-Link après l'avoir retiré de son emballage d'expédition. Si vous décelez un défaut, conservez tout le matériel d'emballage et toutes les factures d'expédition. Toute réclamation pour dommages doit être acheminée rapidement au transporteur. Avisez le représentant Gentec-EO le plus proche à propos de la réclamation, afin que la réparation ou le remplacement puisse être planifié le plus rapidement possible.

Vous pouvez télécharger la plus récente version du logiciel pour le PC S-Link (et l'installer sur votre ordinateur) et pour le S-Link (et l'installer sur le S-Link) avec l'interface série à tout moment à partir de notre site Web www.gentec-eo.com.

Vous pouvez télécharger le programme S-Link à partir de notre site Web. Allez à la section **Downloads** de notre site Web : www.gentec-eo.com. Cliquez sur le nom du fichier pour télécharger celui-ci sur votre ordinateur. Les étapes spécifiques requises varient selon le navigateur Web et les réglages du navigateur. Après l'avoir transféré, ouvrez le fichier sur votre ordinateur et suivez les instructions pour décompresser et installer le fichier. Vous pouvez également consulter la documentation d'instructions sur le téléchargement, qui se trouve aussi dans la section download (téléchargement) de notre site Web.

1.2 CE QUI EST INCLUS AVEC VOTRE S-LINK

S-LINK-1 (202225) et S-LINK-2 (202226)

Description	Numéro d'article
Moniteur S-LINK	
Certificat de calibration	
Câble USB-B 1.8 m	100776

S-LINK-1 Ethernet (201030) et S-LINK-2 Ethernet (201170)

Description	Numéro d'article
Moniteur S-LINK Ethernet	
Certificat de calibration	
Câble USB-B 1.8 m	100776
Câble Ethernet 2.1 m (gris)	101638
Câble croisé Ethernet 2.1 m (orange)	101639

1.3 Spécifications

Les spécifications suivantes sont basées sur un cycle d'étalonnage d'un an, une température de service de 18 à 28 °C (64 à 82 °F) et une humidité relative maximale de 80 %.

Tableau 1-1 Liste de spécifications

	Spécification du mesureur de puissance S-Link
Détecteurs compatibles	XLP, HP, UP, PH (Série B seulement)
Gamme de puissance	1 μ W à 10 kW
Échelles de puissance (Détecteur thermique)	<u>15 échelles</u> : 300 μ W, 1 mW, 3 mW, 30 mW, 100 mW, 300 mW, 1 W, 3 W, 10 W, 30 W, 100 W, 300 W, 1 kW, 3 kW, 10 kW
Résolution (numérique)	Mode normal : Échelle actuelle/2048 Mode Ascii : Échelle actuelle/32768
Précision en mode wattmètre	$\pm 0,75\%$ $\pm 2,5 \mu$ V à partir de 10 % jusqu'à la pleine échelle ¹
Temps de réponse (accélééré)²	1 s
Fréquence d'échantillonnage	100 Hz
Statistiques	Valeur actuelle, max, min, moyenne, déviation standard, stabilité de la valeur efficace (RMS), stabilité point à point (PTP), durée
	Spécification du mesureur d'énergie S-Link
Détecteurs compatibles	QE, UP, XLP en mode énergie, PE, Calorimètres
Gamme d'énergie	8 fJ à 20 kJ
Échelles d'énergie	<u>33 échelles</u> : 1 pJ, 3 pJ, 10 pJ, 30 pJ, 100 pJ, 300 pJ, 1 nJ, 3 nJ, 10 nJ, 30 nJ, 100 nJ, 300 nJ, 1 μ J, 10 μ J, 30 μ J, 100 μ J, 300 μ J, 1 mJ, 3 mJ, 10 mJ, 30 mJ, 100 mJ, 300 mJ, 1 J, 3 J, 10 J, 30 J, 100 J, 300 J, 1 kJ, 3 kJ, 10 kJ, 30 kJ
Résolution (numérique)	Mode normal : Échelle actuelle/4096 Mode Ascii : Échelle actuelle/32768

¹ L'incertitude de 2,5 μ V peut induire une erreur dans les mesures de basse puissance lors de l'utilisation de détecteurs de faible sensibilité. Il est essentiel d'utiliser la remise zéro pour réinitialiser le zéro du S-Link avant de prendre une mesure dans ces conditions. Utiliser la remise à zéro représente toujours une pratique sûre. Voir la section 2.2.

² Varie selon le détecteur.

Précision³	1,0 %±50 µV < 500 Hz 2,0 %±50 µV 500 Hz à 1,2 kHz 3 %±50 µV 1,2 kHz à 6 kHz 6 %±50 µV 6 kHz à 10 kHz
Précision de puissance moyenne	Erreur de précision de la fréquence + précision du joulemètre.
Précision de fréquence	0.1 à 1 000 Hz : 1 % ±0,1 Hz ⁵ 1 000 à 2 000 Hz : 2 % ±0,1 Hz ⁵ 5 000 à 10 000 Hz : 3 % ±1 Hz ⁵
Niveau de déclenchement par défaut	2 %
Niveau de déclenchement du logiciel	0,1 % à 99,9 %, résolution 0,1 %
Transfert de données en temps réel	10 kHz/canal en mode normal aucun point manquant avec USB 2.0 ou Ethernet et ordinateur recommandé.
Statistiques	Valeur actuelle, max, min, moyenne, déviation standard, stabilité de la valeur efficace (RMS), stabilité point à point (PTP), numéro d'impulsion, cadence de répétition, puissance moyenne
Stockage des données	Limité à l'espace libre sur le disque dur du PC
	<i>Spécifications générales du S-Link</i>
Affichage numérique	Écran d'ordinateur
Vitesse d'affichage	3 Hz en mode temps réel. 15 Hz en mode graphique.
Affichages de données	Temps réel, rapport, graphique en temps réel, histogramme, statistiques et histogramme 3D.
Facteurs de correction saisis par l'utilisateur	1 facteur de multiplication et 1 décalage (point flottant de 7 caractères numériques)
Déclencheur externe positif	3 à 24 V pour 13 mA, optoisolé
Largeur d'impulsion du déclenchement externe	2 µs minimum, pas de durée maximale.
Mises à niveau par Internet	Oui (USB uniquement)
Commandes série PC	USB

³ Incluant la linéarité.

⁵ Avec l'ordinateur recommandé, aucun affichage graphique, la latence USB réglée à 1 ms et aucune autre application ne fonctionne. Le taux de répétition est beaucoup plus bas sur le S-LINK RS-232 (5,7 kHz à 115200, 480 Hz à 9600, le taux de répétition est divisé par 2 si deux canaux sont utilisés).

	Facultatif : Ethernet (port COM virtuel ou Telnet) Remarque : Lorsque l'USB est connecté, la communication Ethernet est désactivée.
Dimensions (connecteurs inclus)	147 (L) x 106 (l) x 34 (H) mm
Poids	0,424 kg
Alimentation électrique par USB	Oui
<u>Alimentation électrique externe pour le S-Link –Ethernet et le S-Link –RS232</u>	Entrée : 100/240 VCA 50-60 Hz, sortie 9 VCC 1,66 A
<u>S-LINK-2</u>	2 canaux

Les modèles S-LINK-USB sont fournis avec un câble USB de 180 cm (6 pieds).

Les modèles S-LINK-ETH sont fournis avec un câble Ethernet de 210 cm (7 pieds) et un câble Ethernet croisé (crossover) de 210 cm (7 pieds).

1.4 Descriptions des connecteurs



Illustration 1-2 Connecteurs du S-Link-Ethernet

1- **CONNECTEUR DE L'INTERFACE ETHERNET (en option sur le S-Link) :**


Cette interface permet d'effectuer le contrôle à distance et le transfert de données entre le S-Link et un ordinateur à l'aide d'un réseau Ethernet, d'un routeur sans fil ou d'une connexion directe.

2- Déclenchement externe :

Le connecteur d'entrée est de type BNC femelle. Le déclenchement externe est compatible TTL. Le moniteur détecte le pulse du côté montant du signal du déclencheur externe. Pour mesurer avec précision, le déclenchement doit être tout juste avant l'impulsion du laser, ou juste après. Par exemple

A QE12SP-S-MT a une durée de montée de 20 μ s

Le déclenchement externe doit être 4 μ s avant ou 19 μ s après l'impulsion du laser.

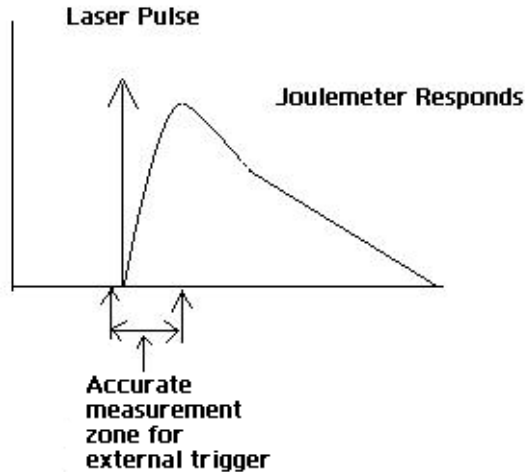


3- CONNECTEUR DE L'INTERFACE USB :

Cette interface offre la possibilité de télécommander et de transférer les données entre le S-Link et un ordinateur doté d'un port de communication USB.

4- PRISE D'ENTRÉE AVEC ALIMENTATION ÉLECTRIQUE EXTERNE (S-Link avec option Ethernet) :

Tension d'entrée requise : 5-9 VCC/500 mA. Si la tension d'entrée se situe entre 15 et 25 volts, le moniteur passera à l'alimentation USB ou se mettra hors tension. Si l'alimentation d'entrée est supérieure à 26 volts, un fusible interne grillera ou le moniteur pourrait être endommagé, selon le niveau de tension et la forme d'onde. Lorsque le S-Link est sous tension, la DEL verte s'allume. Le S-Link fonctionnera dans toutes les conditions avec un détecteur de haute puissance de la série HP et avec toutes les autres têtes prises en charge par Gentec-EO. **Lorsque vous branchez plus d'un détecteur de la série HP, vous devez utiliser l'alimentation USB ou un adaptateur de puissance 5 volts- 500 mA c.a. à c.c. pour alimenter le détecteur HP.**

	<p>AVERTISSEMENT</p> <p>Un dommage permanent au moniteur S-LINK peut se produire si une alimentation électrique externe autre que celle de GENTEC-EO SPU15A-104 est utilisée. Veuillez appeler GENTEC-EO ou votre distributeur local si vous avez besoin d'autres moyens d'alimentation électrique pour une configuration particulière.</p>
---	--

5- PRISE D'ENTRÉE DE LA SONDE :

Le **S-Link** utilise une prise femelle DB-15 pour se connecter au détecteur (sondes).

Le **S-Link** peut tirer profit de nos *Données de correction personnalisées*^{MC}. Il lit la mémoire dans le connecteur *Smart Interface* (versions 5 et supérieures), ce qui offre une correction de

longueur d'onde fondée sur les données spectrales mesurées à partir de ce détecteur spécifique.

Les détecteurs d'énergie des versions 4 ou antérieures requièrent un connecteur de type BNC. Contactez votre fournisseur pour procéder à une mise à jour du matériel.

Les détecteurs de puissance des versions V4 et inférieures et les détecteurs d'énergie des versions V5 et inférieures ne sont pas pris en charge. Les photodiodes ne sont pas prises en charge.

Les détecteurs de puissance des versions V5 et supérieures et les détecteurs d'énergie de la version V6 sont équipés d'un connecteur mâle DB-15 « intelligent » qui s'accouple directement au connecteur femelle DB-15. Ils ne requièrent pas d'adaptateur.

AVERTISSEMENT :

Le connecteur DB-15 du S-Link, même s'il est similaire à ceux des moniteurs précédents TPM-310 et TPM-330, est incompatible avec les têtes de détecteur de puissance des séries PS-310 version 1 et PS-330 version 1. Ces têtes utilisent une technologie différente et ne possèdent pas la même configuration de broches de sortie.

Toute tentative de modifier les connecteurs des têtes de versions antérieures pour les coupler avec le S-Link pourrait entraîner un dommage au moniteur.

6- CONNECTEUR DE L'INTERFACE RS-232 (uniquement sur le S-Link-1-RS-232) :

Cette interface offre la possibilité de télécommander et de transférer les données entre le S-Link et un ordinateur doté d'un port de communication RS-232. La vitesse est sélectionnée à l'usine. Le connecteur est un mini-USB standard.

Pour commencer



Cette section contient de l'information importante à propos de l'installation et du fonctionnement du S-Link.

Le S-Link est prêt à être utilisé à la livraison. Insérez simplement la prise DB-15 male du détecteur dans la prise d'entrée du détecteur DB-15 du S-Link, insérez le câble USB dans le S-Link et dans l'ordinateur, et lancez le logiciel.

1.5 Procédure de mesures de puissance et d'énergie rapide

Cette section est applicable pour toutes les versions de S-Link. Elle vous présente la façon la plus rapide pour prendre une mesure d'énergie et de **puissance laser** en utilisant le S-Link et un détecteur de puissance ou d'énergie Gentec-EO.

Le moniteur reconnaît automatiquement toutes les **têtes haute puissance des versions ≥4 et** les têtes d'énergie des versions ≥ 6 de Gentec-EO. Toutes les données techniques sur mesure requises pour un fonctionnement optimal du détecteur seront automatiquement téléchargées à partir de la mémoire EEPROM dans le connecteur de type DB-15. Ces données incluent la sensibilité, le modèle, le numéro de série, la version, les facteurs de correction de longueur d'onde et le temps de réponse.

Les 11 premières étapes servent à procéder à l'initialisation du S-Link, les étapes 12 à 14 se reportent au PC S-Link :

- 1- Installez le détecteur d'énergie ou de puissance sur son support optique.
- 2- Mettez le S-Link hors tension (débranchez-le) et branchez un détecteur de puissance ou d'énergie de version 5 (ou supérieure) au S-Link à l'aide de **l'entrée du détecteur DB15**. Mettez le S-Link hors tension avant de brancher une nouvelle tête, afin d'éviter toute perte d'information. Le S-Link lit seulement l'EEPROM si on débranche/rebranche l'alimentation ou sur une commande de réinitialisation de l'appareil. Sinon, l'appareil conserve la sensibilité et la configuration de la dernière tête. Afin d'éviter la perte d'information, assurez-vous de ne pas insérer une tête pendant que le S-Link est en train d'être mis sous tension, ou pendant que vous envoyez la commande de réinitialisation de l'appareil.
- 3- Faites glisser le loquet vers la gauche pour verrouiller le connecteur DB-15 en place.
- 4- Allumez le S-Link (en le branchant).
- 5- Les têtes de puissance mettent par défaut le S-Link en mesure de puissance, les têtes d'énergie mettent par défaut le S-Link en mesure d'énergie.
- 6- Retirez le couvercle protecteur du détecteur.

Mettez le détecteur dans le parcours du faisceau laser. Le faisceau laser complet doit se trouver dans l'ouverture du capteur. Ne dépassez pas les densités, énergies ou puissances maximales spécifiées. Pour obtenir la mesure la plus précise, étendez le faisceau sur 60 % à 80 % de la surface du capteur.

Attention : les détecteurs de puissance peuvent être utilisés avec des lasers en continu et des lasers pulsés.

- Les détecteurs d'énergie peuvent être utilisés uniquement avec les lasers pulsés.

- 7- Pour les détecteurs de puissance (en utilisant le S-Link), allez à l'étape 8. Pour les détecteurs d'énergie, allez à l'étape 11.

Réglage du zéro (étapes 8 à 10)

- 8- Bloquez tout rayonnement laser sur le détecteur.
- 9- Il est possible que la lecture de puissance par le PC S-Link ne soit pas exactement zéro en l'absence de faisceau laser incident sur le détecteur. Le détecteur n'est pas stabilisé thermiquement OU il y a une source de chaleur dans le champ de vision du détecteur au moment de la mise en fonction du S-Link (ON).
- 10- Pour réinitialiser le zéro, attendez jusqu'à ce que la lecture soit stabilisée, cliquez à droite et sélectionnez "**Zero Offset**". Vous pouvez maintenant prendre une lecture précise.

Remarques :

- Veuillez consulter la documentation portant sur le détecteur de puissance spécifique, pour obtenir des directives complètes sur l'installation et le fonctionnement.
- Les détecteurs de puissance sont des capteurs thermiques sensibles aux variations de température.

Pour obtenir des mesures de grande précision, il est recommandé de :

- Permettre à la température du détecteur de puissance de se stabiliser avant d'ajuster le zéro du S-Link.
 - Ne pas toucher le détecteur lors de sa manipulation. Touchez au support.
 - Évitez les courants d'air autour du détecteur.
- 11- Appliquez le faisceau laser sur le senseur du détecteur. L'énergie ou la puissance moyenne du faisceau laser sera affichée sur l'écran de l'ordinateur.
 - 12- Si les pilotes USB et/ou le PC S-Link n'ont pas été installés, installez les pilotes USB (voir 3.1.1), puis installez le PC S-Link (autodirigé).
 - 13- Démarrez le logiciel PC S-Link sur l'ordinateur. Cliquez sur **Start / Programs /GENTEC-EO/ PC S-Link**.
 - 14- Pour brancher le PC S-Link sur l'appareil, sélectionnez le bon port **COM** (voir section 3.2.1) et cliquez sur "**Reconnect**" (reconnexion). Vous devriez voir les valeurs qui se rapportent aux réglages actuels sur le PC S-Link.
 - 15- Pour remplacer le détecteur, désactivez le PC S-Link, débranchez le S-Link, branchez le nouveau détecteur, rebranchez le S-Link et redémarrez le PC S-Link.

1.6 INTERFACE UTILISATEUR

1.6.1 Démarrez le logiciel PC S-Link sur l'ordinateur. Cliquez sur **Start / Programs /GENTEC-EO/ PC S-Link**.

1.6.2 Établir une connexion avec le S-Link

Sélectionnez "**Communication/Open**" (communication/ouvrir) et sélectionnez le port COM, voir la section 1.7.


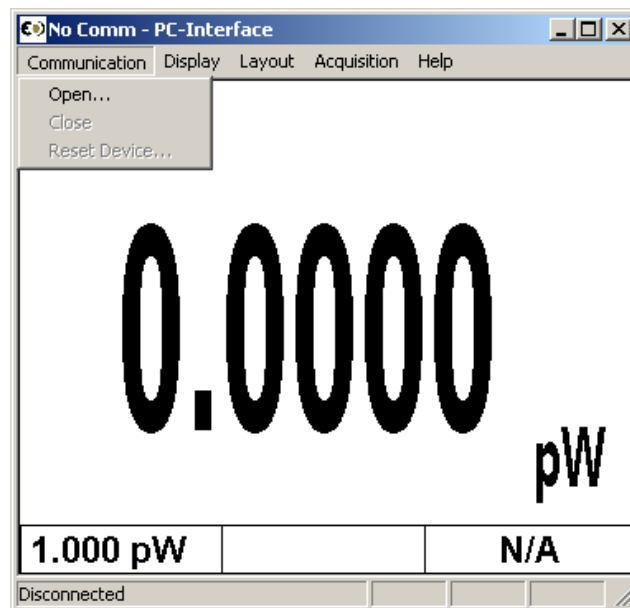


Image de communication

1.6.3 L'affichage en temps réel

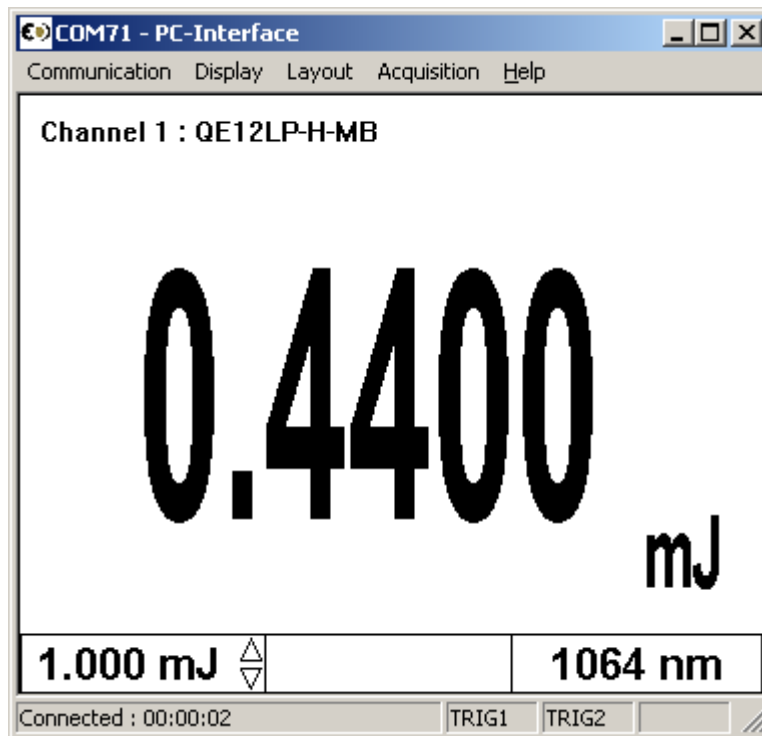

En mode puissance

La valeur actuelle est mise à jour à 3 Hz.

La fenêtre inférieure illustre l'échelle, la valeur du zéro actuelle et la longueur d'onde. Vous pouvez changer l'échelle en utilisant les flèches rapides situées à côté de la valeur de l'échelle. Lorsque vous changez l'échelle, tous les modes d'affichage et l'acquisition arrêteront durant quelques millisecondes.

En mode énergie

La valeur actuelle est mise à jour à 3 Hz. Mais toutes les données dans les statistiques sont mises à jour jusqu'à 10 kHz en temps réel. La prise d'une seule lecture est toujours bonne. Lorsque vous changez l'échelle, vous pouvez obtenir une fausse lecture, mais la prochaine lecture sera précise. La mise à zéro « Zéro Offset » n'est pas requis en mode énergie, car le S-Link compense la déviation analogique.

La barre d'information en bas illustre l'échelle et la longueur d'onde. La case du milieu est vide en mode énergie. Vous pouvez changer l'échelle en utilisant les flèches rapides situées à côté de la valeur de l'échelle. Lorsque vous changez l'échelle, tous les modes d'affichage et l'acquisition arrêteront durant quelques millisecondes.

1.6.4 La fenêtre de l'état (Status Window)

Dans la fenêtre de l'état, vous pouvez sélectionner le canal, l'échelle, la longueur d'onde, le niveau du déclencheur, le facteur de correction, le nom du fichier, l'échantillon de données et l'option de déclenchement externe. Toutes les acquisitions et les mesures cessent pendant que vous êtes dans la fenêtre de l'état. Pour sauvegarder vos réglages, sélectionnez "**File / Save Status**" (fichier/sauvegarder l'état). Pour charger vos réglages, sélectionnez "**File / Load Status**" (fichier/sauvegarder l'état). Vous ne devez pas charger un état de wattmètre lors de l'utilisation d'un détecteur d'énergie, ou un état de joulemètre lors de l'utilisation d'un détecteur de puissance. Le PC S-Link se souviendra de vos paramètres sauvegardés dans l'onglet "File".

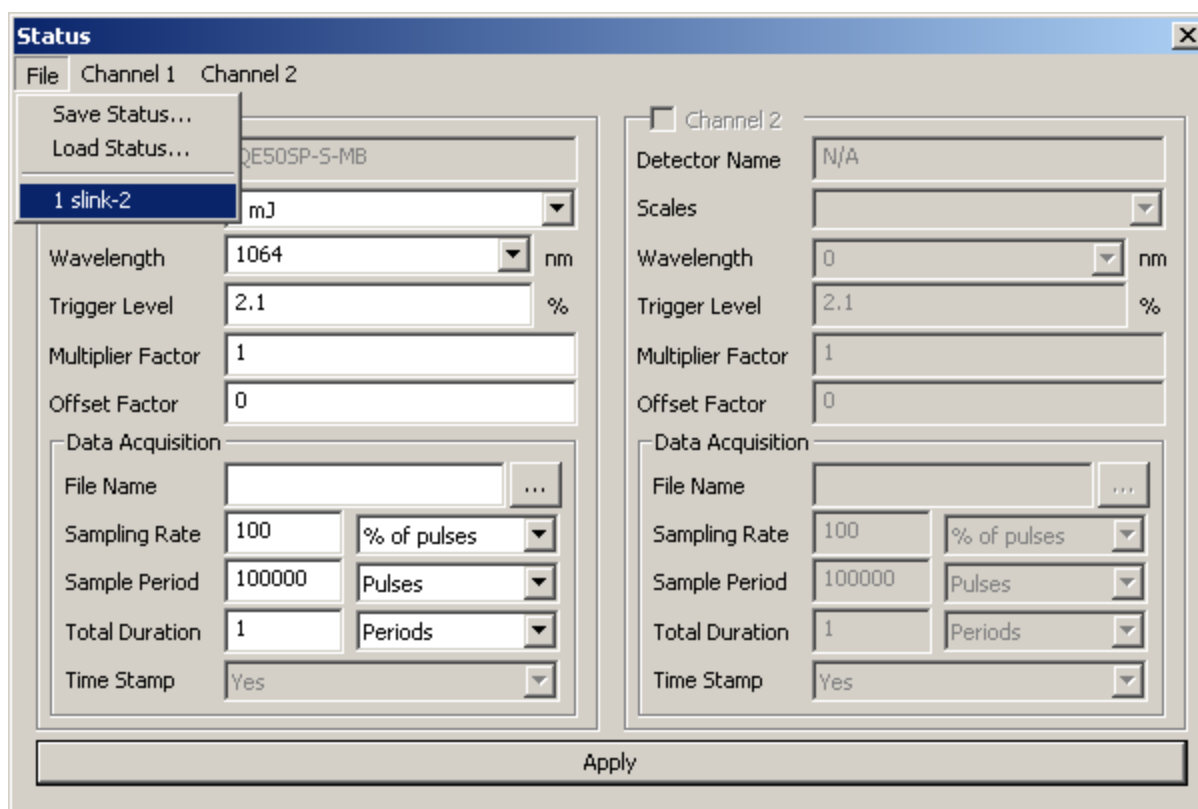



Image de l'état

1.6.5 Sélectionner le canal à afficher


Faites un clic droit dans la fenêtre d'affichage, et sélectionnez le canal que vous souhaitez afficher.

1.6.6 Ajuster l'affichage des fenêtres


Sélectionnez "**Display/Split**" (affichage/divisé) par un clic droit dans la fenêtre ou à partir de la barre de menu. Pour sauvegarder votre mise en page, sélectionnez "**Layout**" (mise en page), et "**Save Layout**" (sauvegardez la mise en page). Pour charger la mise en page que vous avez sauvegardée, sélectionner "**Load Layout**" (charger la mise en page) ou le nom de la mise en page qui apparaît dans l'onglet "**Layout**".

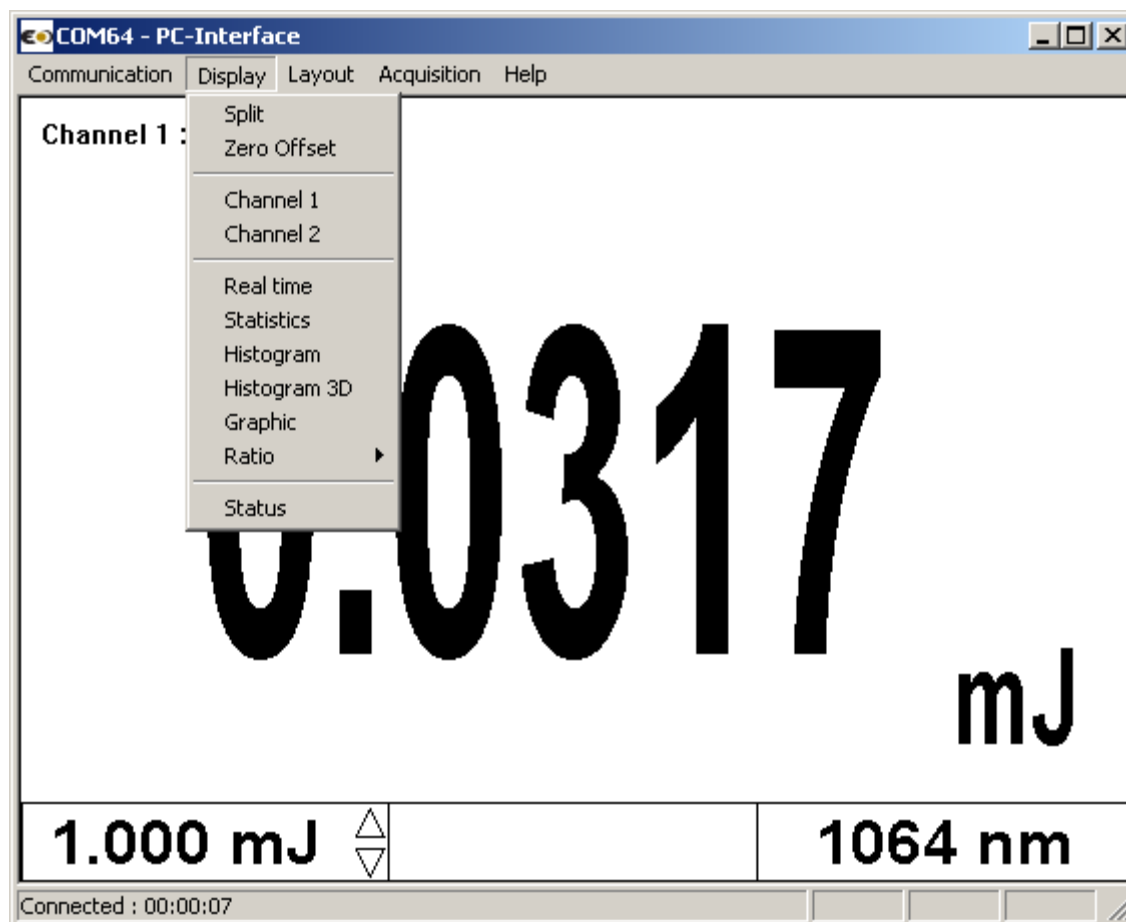

1.6.7 Le graphique

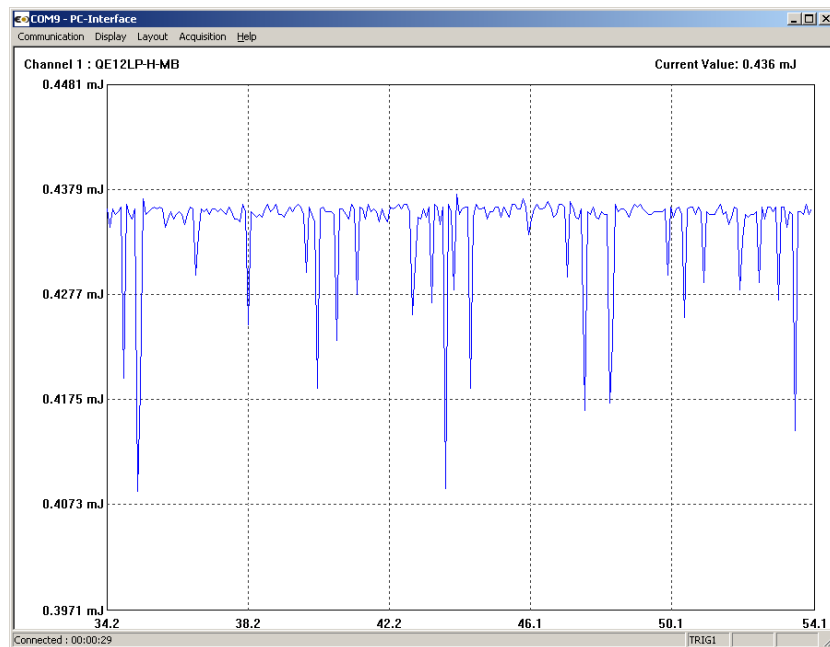

Pour régler le graphique du temps réel, double cliquez sur le côté gauche de l'axe vertical (y). Les réglages minimum et maximum de l'axe horizontal sont uniquement disponibles dans l'option "**Load File**" (charger le fichier). Vous pouvez utiliser la roulette de la souris pour grossir ou rapetisser l'image. Faire un clic gauche sur la ligne du graphique pour changer la position de la ligne. Double cliquez autour du graphique pour faire pause et pour obtenir les valeurs numériques qui se trouvent sur le graphique. Le réglage du temps pour l'axe horizontal "**time**" se trouve dans ce menu.

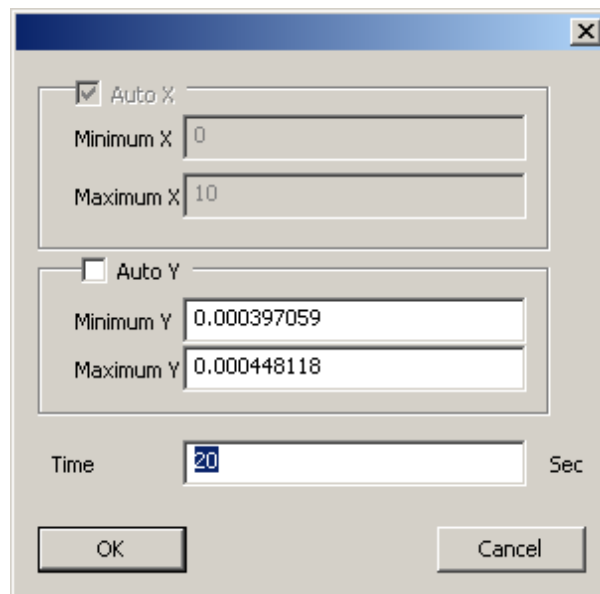

1.6.8 L'option du mode graphique après le chargement d'un fichier

Dans le menu "**Status**"(état), sélectionnez un nom de fichier pour le fichier à sauvegarder ou à visionner.

Pour régler l'axe du graphique, double cliquez sur le côté gauche de l'axe vertical. Désélectionnez le mode automatique pour saisir les valeurs de l'axe. Vous pouvez également utiliser la roulette de la souris pour agrandir ou rapetisser l'image. Vous pouvez agrandir l'axe horizontal en utilisant la roulette de la souris et en maintenant la touche Shift du clavier. Cliquez à gauche sur le graphique pour changer la position de la ligne verticale. Si vous agrandissez l'axe horizontal, vous pouvez cliquer à gauche sur le graphique et déplacer la position du centre de l'axe horizontal. Double cliquez sur la fenêtre du graphique pour faire une pause et pour obtenir les valeurs numériques qui se trouvent sur le graphique.




Pour agrandir l'axe vertical



Pour agrandir l'axe horizontal dans l'option **Load File** (charger le fichier)


1.6.9 Redémarrer le graphique en temps réel, les statistiques et l'histogramme

Chaque fenêtre est autonome. Vous pouvez effacer chaque fenêtre ou utiliser le menu « Clear All » (tout effacer). Vous pouvez faire un clic droit dans la fenêtre pour sélectionner « Clear » (effacer) ou « CLEAR ALL » (tout effacer). Lorsque vous sélectionnez « Clear the graphic » (effacer le graphique), l'histogramme et les statistiques redémarrent.

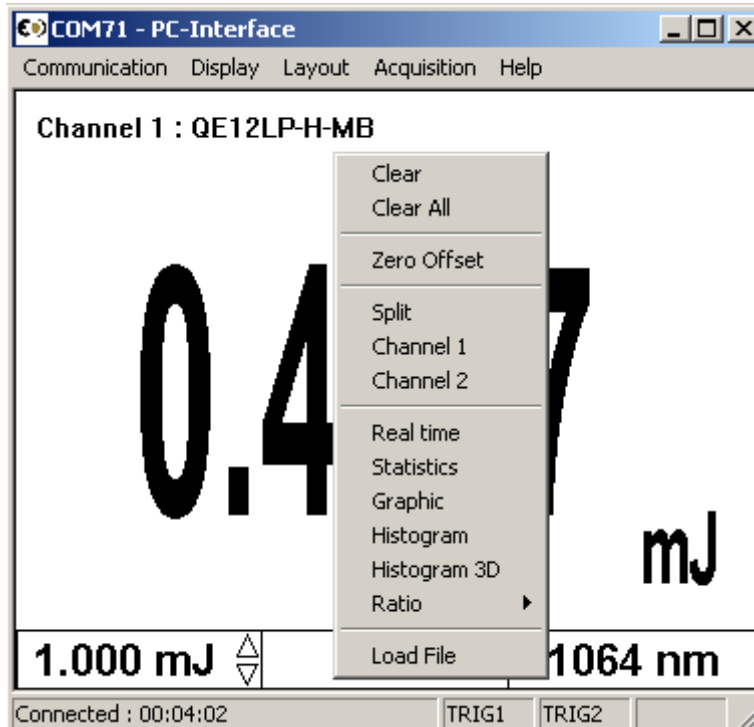

1.6.10 Faire une acquisition

Pour commencer une acquisition, vous devez saisir le nom du fichier dans le menu "**Status**" (état) et sélectionner "**Acquisition/Channel**" (acquisition/canal). Un message d'enregistrement apparaîtra au bas de l'écran durant l'enregistrement. Pour arrêter l'acquisition, resélectionnez "**Acquisition/Channel #**". Les flèches de changement d'échelle sur l'affichage du temps réel sont indisponibles durant l'acquisition. Si vous ne sélectionnez pas un répertoire, tous les fichiers sauvegardés se trouveront dans C:\Program Files\Gentec-EO\S-Link.

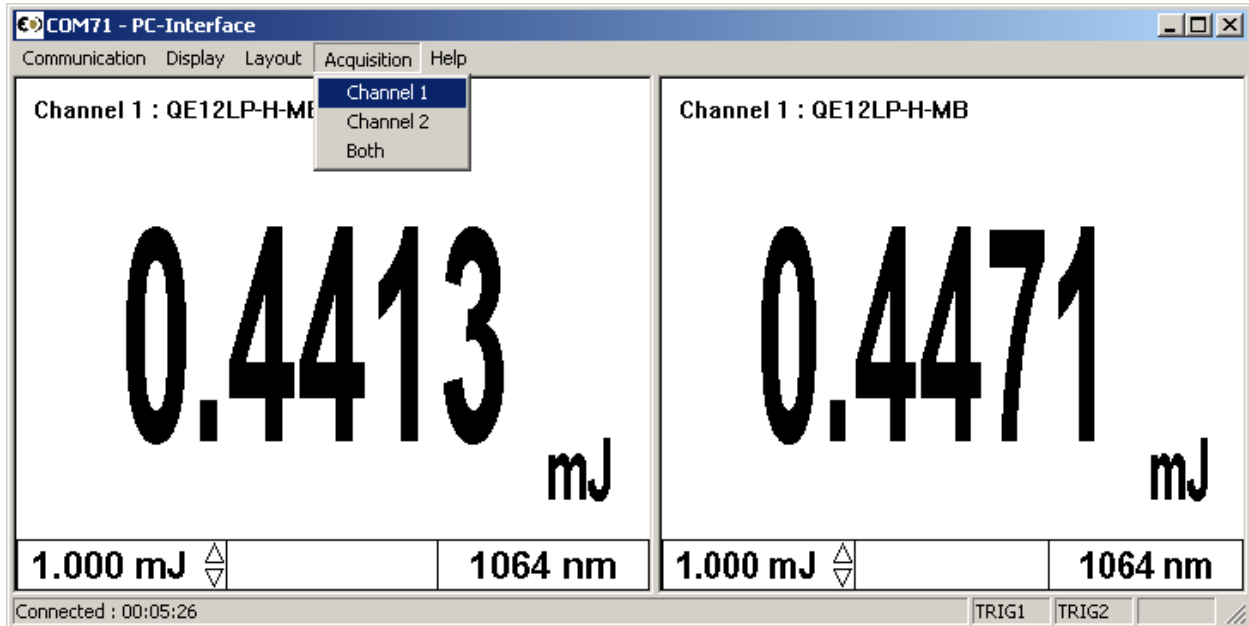

1.6.11 Mettre en pause les statistiques et le graphique en temps réel

Cliquez sur la fenêtre de statistiques ou sur le graphique en temps réel.

1.6.12 Faire une remise à zéro


Pour les détecteurs de puissance uniquement, faire un clic droit sur l'une des fenêtres et sélectionnez « **Zero Offset** » (remise à zéro), la valeur du zéro sera affichée au centre inférieur de l'affichage de temps réel.

1.6.13 Mode rapport (Ratio)

En mode énergie, le rapport est effectué avec la dernière mesure reçue par le S-Link. Le rapport ne fonctionne pas si vous utilisez une tête de puissance et une tête d'énergie.

Exemple :

Valeur du laser canal #1	Valeur du laser canal #2	Résultats CH1/CH2
10 J	5 J	2
Aucune impulsion	2 J	5
8 J	Aucune impulsion	4
12 J	4 J	3

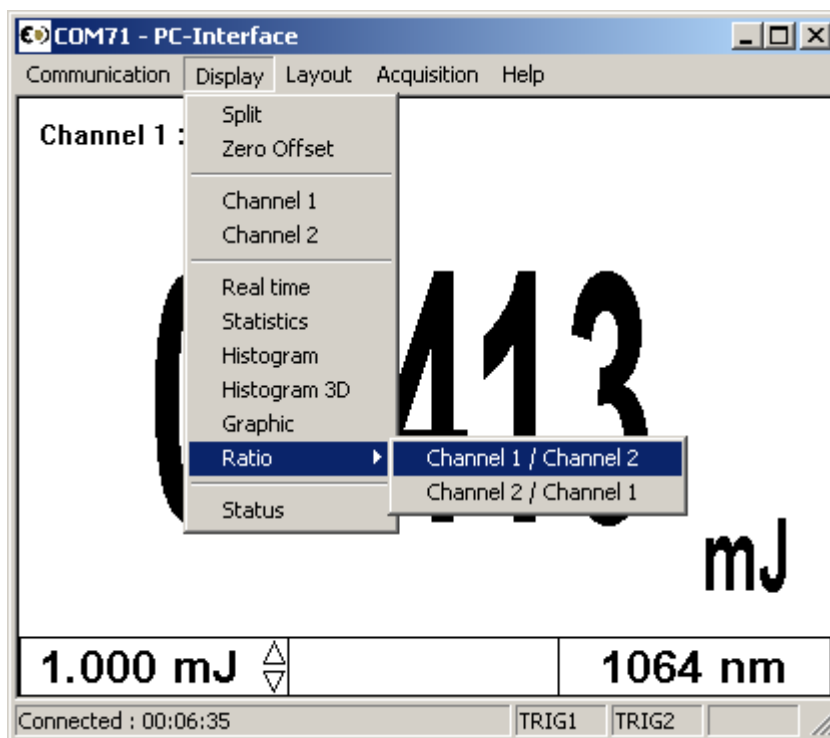


1.6.14 Détecter des impulsions laser manquantes.


Le S-Link détecte les impulsions de laser manquantes, en utilisant le déclencheur externe et l'affichage de l'histogramme.

Étape 1 : Branchez le déclencheur externe de votre laser au déclencheur externe du S-Link, en utilisant le connecteur de type BNC.


Étape 2 : Sélectionnez le déclenchement externe à partir de la fenêtre "Status" (état).

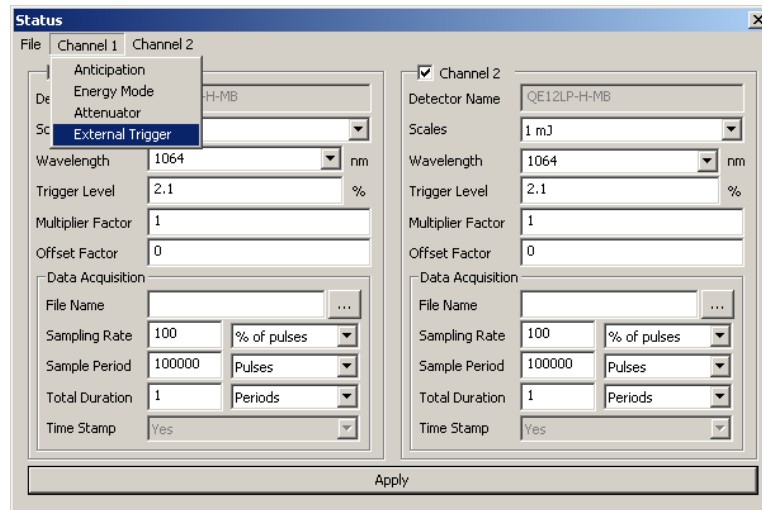

Étape 3 : Sélectionnez l'affichage de l'histogramme, qui se trouve dans le menu affichage.

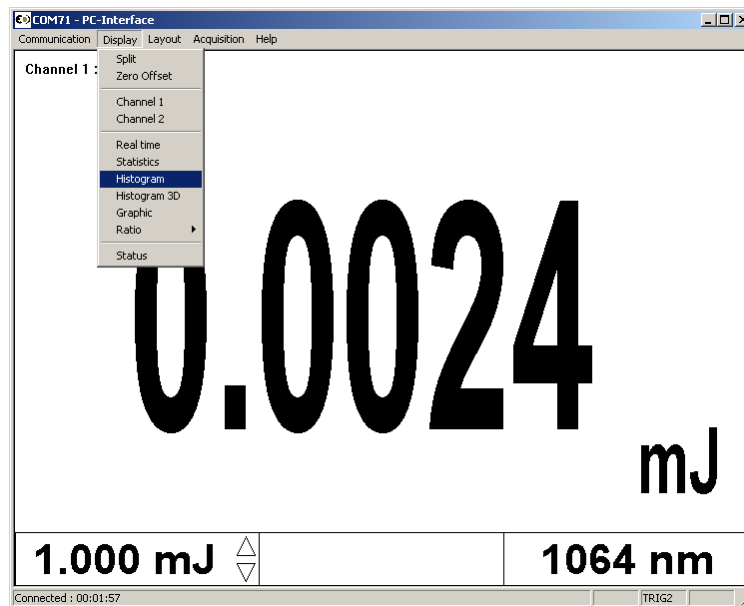


Étape 4 : Démarrer votre laser et placez votre curseur sur l'axe vertical à gauche. Le nombre d'impulsions manquantes est situé dans le coin supérieur droit de l'histogramme. Réinitialisez l'histogramme, en utilisant la commande "clear" d'effacement.

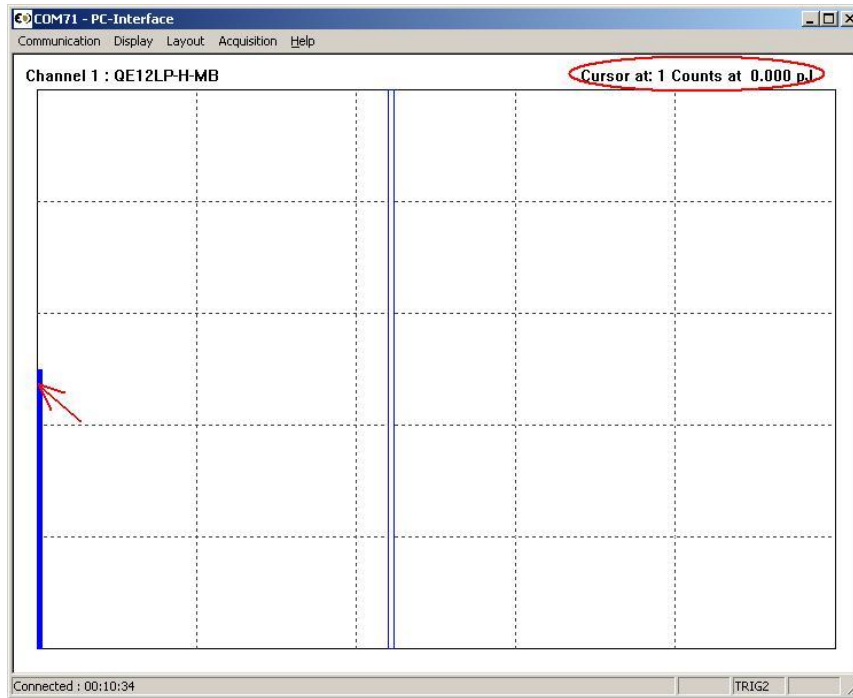


1.6.15 Ordinateur recommandé

Les fonctions de base fonctionneront bien sur des ordinateurs des années 2004 et ultérieures. Si vous voulez mesurer plus de 1 kHz et/ou afficher l'histogramme 3D, vous devez avoir un ordinateur et une carte graphique comme Intel core 2 CPU 6420 2,13 GHz, 4 de ram et un Nvidia Geforce 7300 LE ou mieux. Si vous voulez être certain de capturer tous les points et que vous avez une fréquence laser supérieure à 1 kHz, ne faites pas fonctionner d'autres programmes en même temps. Si vous voulez une lecture de fréquence très précise et une puissance moyenne en mode énergie, ne faites pas fonctionner l'affichage graphique 3D. Les systèmes d'exploitation pris en charge sont Windows XP et Vista.

En mode statistiques, la mesure de la fréquence se réinitialise par elle-même, après que le nombre d'impulsions ait atteint le nombre d'impulsions établi dans le menu "**Status**" (état). Si vous voulez que la réinitialisation se produise moins fréquemment, établissez un nombre très élevé. Pour avoir une mesure de fréquence précise au-dessus de 1 kHz, régler la minuterie de latence à 1 ms dans les réglages avancés USB. Pour accéder au menu de la minuterie en latence, dans Device Manager, cliquez sur **Start** → **Settings** → **Control Panel** → **System** → **Device Manager** (Démarrage → Propriétés → Panneau de contrôle → Système → Gestionnaire de périphérique).

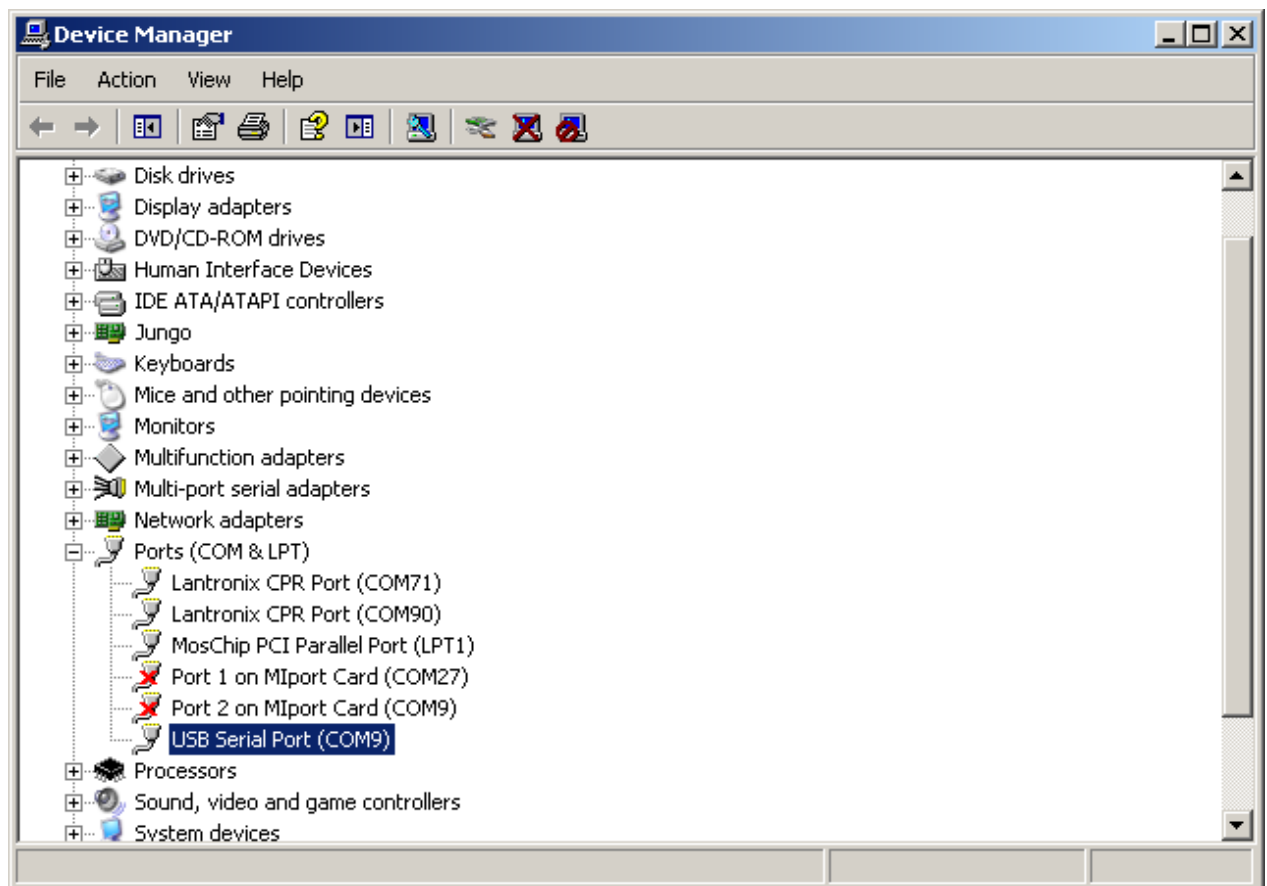

Allez aux propriétés du port USB, sélectionnez les paramètres du port et sélectionnez **Advanced** (avancé).

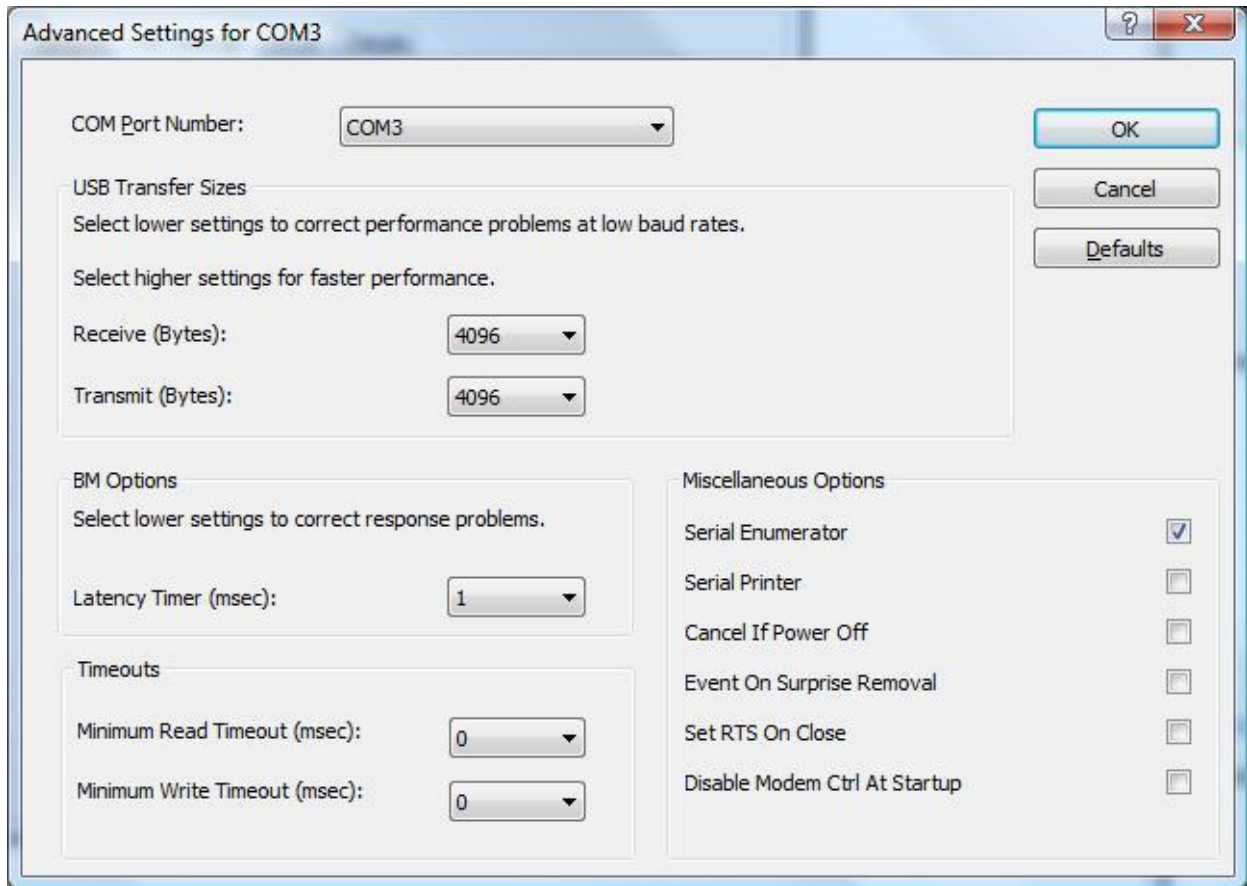

Installation et communication



1.7 Installation

Le S-Link n'est pas requis pour l'installation du logiciel PC S-Link. Toutefois, il peut être connecté sans que cela n'ait d'effet. Assurez-vous que le S-Link soit branché au port USB lorsque vous êtes prêt à faire fonctionner le logiciel PC S-Link.

Branchez le port USB du S-Link, situé sur le panneau du dessus de l'appareil (voir l'illustration 1-2), au connecteur série du dispositif hôte, en utilisant le câble approprié. Le S-Link vient équipé d'un câble USB standard.

Vous devez installer les pilotes USB.

1.7.1 Installation des pilotes USB pour Windows™ :

Branchez le S-Link sur un port USB du PC. Si le PC prend en charge USB 1.1, Windows détecte le nouveau périphérique et vous demande les pilotes. Une fenêtre indiquant **Found New Hardware – USB Device** (nouveau matériel - dispositif USB détecté) s'ouvrira, et après quelques secondes, le **Found New Hardware Wizard** (Assistant du nouveau matériel détecté) apparaîtra.

Insérez le CD-ROM avec le pilote USB si ce n'est pas déjà fait.

Annulez l'assistant et exécutez le module d'installation automatique « USB driver installer-R2 » (installateur de pilote USB - R2) qui se trouve dans le dossier Pilote USB du CD-ROM.

À la fin de ce processus, un nouveau port COM série est ajouté à la liste des ports de communication. Il peut être utilisé comme tout autre port série. Vous aurez besoin de connaître le numéro du port COM pour configurer la connexion série au S-Link.

1.8 Configuration de la communication vers le S-Link

1.8.1 Vérification du port COM

Pour vérifier l'installation USB et repérer le numéro du port COM, cliquez sur :

Start (Démarrer) → Settings (Paramètres) → Control Panel (Panneau de configuration) → System (Système) → Device Manager (Gestionnaire de périphérique)

Descendez jusqu'à **Ports (COM & LPT)** et double-cliquez cette ligne. Une des options offertes sera **USB-to-Serial (COM#)**.

Notez le numéro de port COM. Vous en aurez besoin à la prochaine étape.

1.8.2 Réduire le réglage du temps de latence

Pour obtenir un marqueur temporel plus précis "**TimeStamp**", réduire le réglage de la le temps de latence pourrait être nécessaire.

La minuterie de latence "**Latency Timer**" représente le nombre limite de cycles de minuterie durant lequel l'appareil peut transférer des données. Réduire ce paramètre priorisera l'échange de données entre les dispositifs, ce qui permet un transfert plus fluide et un marqueur temporel "**Time Stamp**" plus précis.

Ouvrez le panneau de contrôle et sélectionnez "Device Manager" (Gestionnaire des périphériques). Dans les catégories de matériel, vous devriez voir une catégorie de Ports, cliquez alors sur le signe « + » à côté de celle-ci. Sélectionnez le bon numéro de port COM, et cliquez sur "Properties" (Propriétés).

Sélectionnez l'onglet "Port Settings" (Réglages du port) et cliquez sur "Advance" (Avancé). Dans l'option BM, réduisez le réglage de 16 à 1 et cliquez sur OK. Cliquez sur OK sur la feuille "Properties Sheet" (Feuille de propriétés) et fermez le "Device Manager" (Gestionnaire des périphériques).

1.8.3 Branchement du PC S-Link au S-Link

1.8.3.1 Téléchargement du fichier PC S-Link et le faire fonctionner

Téléchargez le PC S-Link à partir de notre site Web, www.gentec-eo.com/downloads, qui se trouve dans la section Downloads (téléchargements). Procédez au téléchargement du fichier en double cliquant sur celui-ci, ou, si le navigateur Internet comporte l'option d'exécuter le fichier, l'exécuter à partir de son emplacement actuel sur le site Web. Le SLINK-X-RS-232 n'est pas pris en charge dans le PC-SLINK (visitez notre site Web pour prendre connaissance des mises à jour).

1.8.3.2 Installation

Lors de l'installation du programme S-Link, appuyez sur le bouton Next (suivant) jusqu'à ce qu'il s'installe par lui-même.

1.8.4 Faire fonctionner le PC S-Link

1.8.4.1 Démarrer PC S-Link

Assurez-vous que le S-Link est branché à l'ordinateur, soit en utilisant le port du câble USB ou une alimentation électrique externe de 9v pour l'option Ethernet. Voir #1.7.1. Vérifiez le port COM pour s'assurer que la connexion est correcte. Démarrer PC S-Link en cliquant sur le menu **Start** → **Programs** → **Gentec-eo** → **PC-interface(S-Link) Start**.

1.8.4.2 S'assurer que le bon port de communication est sélectionné

S'assurer que le bon port COM est sélectionné dans la section "Status Info" (information sur l'état) du programme. Si le PC S-Link ne parvient pas à communiquer avec le S-Link, un message d'erreur comme « Ne peut communiquer avec l'appareil, veuillez vérifier les connexions » est affiché dans la section Notification du programme, tout juste à côté de la lumière qui clignote (indiquant une erreur). Vous devez refaire la connexion si vous changez la connexion physique ou le port COM.

1.8.4.3 Sortir du programme PC S-Link

Pour sauvegarder des réglages importants du PC S-Link, sortez en utilisant le menu File > Exit ou le raccourci Ctrl-F4. PC S-Link.

1.8.5 Branchement au S-Link

Utiliser votre émulateur de terminal série préféré pour vous connecter au port COM. Voici quelques exemples de programmes de terminaux série :

CoolTerm : <https://freeware.the-meiers.org/>

PuTTY : <http://www.putty.org/>

RealTerm : <https://realterm.sourceforge.io/>

Si vous avez besoin de connaître le numéro de port COM, vous pouvez le trouver dans le Gestionnaire de périphériques Windows.

Utiliser les paramètres de communication suivants :

Communication ETHERNET et USB

Bits par seconde	921 600
Bits de données	8
Parité	Aucun
Bits d'arrêt	1
Contrôle de flux	Aucun

Communication du RS-232

Bits par seconde	9 600 ou 115 200 (ajusté à l'usine)
Bits de données	8
Parité	Aucun
Bits d'arrêt	1
Contrôle de flux	Aucun

1.8.6 Pour mettre les commandes en écho

Les commandes que vous tapez n'apparaîtront pas dans la fenêtre du terminal à moins que vous n'ayez configuré l'émulateur de terminal pour le faire. Seule la réponse du moniteur sera affichée. Si vous préférez voir les commandes que vous tapez, activez "Local Echo" ou un paramètre équivalent.

1.8.7 Testez la connexion

Dans la fenêtre du terminal saisissez ***VER**, appuyez sur ↵ **ENTER**. Si la réponse obtenue correspond à la version de votre S-Link, vous êtes bien connecté et prêt à la commande en série.

1.9 Commandes séries du S-Link

L'étoile (*) fait partie de chaque commande.

*AT1x *AT2x	/	<p>Pour régler l'atténuateur au canal 1 ou au canal 2.</p> <p>x= 0 = désactiver, x = 1= activer</p> <p>La valeur par défaut est 0.</p> <p>Exemple : Saisir *AT10 pour désactiver l'atténuateur du canal 1. Exemple : Saisir *AT21 pour activer l'atténuateur du canal 2.</p>
*CA1 *CA2	/	<p>Pour acheminer les points de données du canal 1 ou 2 par l'entremise du port série à la fréquence du laser pour la tête d'énergie, ou à 100 Hz pour la tête de puissance.</p> <p>La sortie en mode ASCII est :</p> <p>Wattmètre : résolution à 6 chiffres en watts</p> <p>Exemple :</p> <p>1:0,001101 : 1,1001 mW sur le canal 1.</p> <p>2:100,231 : 100,231 watts sur le canal 2.</p> <p>Mode énergie : 4 caractères en notation scientifique.</p>

	<p>2:8.808e-07 : 0,8808 µJ sur le canal 2</p> <p>Si vous avez un taux de répétition plus élevé que celui de la spécification ASCII, le moniteur achemine un message d'erreur. Dans ce cas, essayez d'acheminer la commande *SS100X afin d'ignorer certaines impulsions laser.</p> <p>Par défaut, le moniteur est réglé en mode binaire. Pour régler le mode ASCII, envoyez la commande sérielle *SS1001 pour le canal 1 ou *SS2001 pour le canal 2.</p>
*CS1 *CS2	<p>/ Pour arrêter/sortir du mode *CA1 ou *CA2.</p>
*AN1x *AN2x	<p>/ Uniquement pour les têtes de puissance. Pour régler l'anticipation pour le canal 1 ou le canal 2.</p> <p>x= 0 = désactiver, x = 1= activer</p> <p>La valeur par défaut est 1.</p> <p>Exemple : Saisir *AT10 pour désactiver l'anticipation du canal 1.</p> <p>Exemple : Saisir *AT21 pour activer l'anticipation du canal 2.</p>
*RST	<p>Pour réinitialiser l'appareil. Le moniteur lira l'EEPROM de la tête à nouveau.</p>
*PW1 *PW2	<p>/ Pour régler la longueur d'onde pour le canal 1 ou le canal 2.</p> <p>Commande de correction de longueur d'onde (+ 5 caractères).</p> <p>Exemple : Pour sélectionner la longueur d'onde 1 064 nm, saisir *PW101064.</p> <p>Exemple : Pour sélectionner la longueur d'onde 10 600 nm, saisir *PW110600.</p>
*TL10002 / *TL20002	<p>Pour modifier le niveau du déclencheur en mode énergie</p> <p>*TL1XXXX / *TL2XXXX où XXXX sont les quatre caractères qui représentent le niveau de déclenchement (en pourcentage) requis. par exemple :</p> <p>XXXX = 0002 pour un niveau de déclencher de 2 % XXXX = 00.5 pour un niveau de déclencher de 0,5 % XXXX = 11.4 pour un niveau de déclencher de 11,4 % XXXX = 0050 pour un niveau de déclencher de 50 %</p> <p>Note : le « . » est un caractère.</p>
*VER	<p>Pour afficher la version du logiciel.</p>
*ST1/ *ST2	<p>Pour afficher l'information à propos de l'état actuel.</p> <p>Voir le tableau 1.</p>
*SSX000	<p>Pour établir le mode binaire ou ASCII.</p> <p>Exemple :</p>

	<p>*SS1000 : Mode binaire pour le canal 1</p> <p>*SS1001 : Le mode ASCII achemine tous les points</p> <p>*SS1002 : Le mode ASCII achemine 1 des 2 points</p> <p>*SS1003 : Le mode ASCII achemine 1 des 3 points</p> <p>*SS1999 : Le mode ASCII achemine 1 des 999 points (999 est le maximum)</p> <p>*SS2001 : Le mode ASCII achemine tous les points pour le canal 2</p> <p>Par défaut la valeur est 0 (mode binaire).</p> <p>Veuillez contacter Gentec-EO pour connaître la description du mode binaire.</p> <p>Remarque : Le PC-Slink ne fonctionnera pas si vous régler le S-Link en mode ASCII.</p>
<p>*SU1 / *SU2</p>	<p>Pour changer d'échelle vers le haut pour le canal 1 ou le canal 2.</p> <p>Vous devez interrompre l'acquisition continue (*CS1, *CS2) avant d'envoyer cette commande.</p>
<p>*SD1 / *SD2</p>	<p>Pour changer d'échelle vers le bas pour le canal 1 ou le canal 2.</p> <p>Vous devez interrompre l'acquisition continue (*CS1, *CS2) avant d'envoyer cette commande.</p>
<p>*ET1x / *ET2x</p>	<p>Pour régler le déclencheur externe pour le canal 1 ou le canal 2.</p> <p>x= 0 = désactiver, x = 1= activer</p> <p>La valeur par défaut est 0.</p> <p>Exemple : Pour désactiver le déclencheur externe pour le canal 1 ou 2, saisissez *ET10.</p> <p>Exemple : Pour activer le déclencheur externe pour le canal 2, saisissez *ET21.</p> <p>Vous devez interrompre l'acquisition continue (*CS1, *CS2) avant d'envoyer cette commande.</p>
<p>*EM1x / *EM2x</p>	<p>Uniquement pour les têtes de puissance. Pour régler le mode énergie au canal 1 ou au canal 2.</p> <p>x= 0 = désactiver, x = 1= activer</p> <p>La valeur par défaut est 0.</p> <p>Exemple : Pour désactiver le mode énergie pour le canal 1, saisissez *ET10.</p> <p>Exemple : Pour activer le mode énergie pour le canal 2, saisissez *ET21.</p> <p>Vous devez interrompre l'acquisition continue (*CS1, *CS2) avant d'envoyer cette commande.</p>

*NMV	<p>Activer le mode de reconnaissance.</p> <p>Cette fonction programme le S-Link pour qu'il achemine un ACK (reconnaissance) après chaque commande série reçue.</p> <p>Le PC S-Link ne fonctionnera pas, si vous acheminez cette commande sans acheminer aussi le *NMQ, *RST ou ne faites pas un cyclage de l'alimentation avant d'essayer de faire une connexion.</p>
*NMQ	Désactiver le mode *NMV (mode par défaut).
*NA1 / *NA2	Renvoie le nom du détecteur pour le canal 1 ou le canal 2.
*SN1 / *SN2	Renvoie le numéro de série du détecteur pour le canal 1 ou le canal 2.
*CV1 / *CV2	<p>Renvoie la dernière mesure du S-Link pour le canal 1 ou le canal 2. Ce mode est uniquement disponible en mode ASCII.</p> <p>Pour le mode joulemètre, elle sera la plus récente valeur d'impulsion laser, en mode wattmètre, elle sera la plus récente mesure prise.</p> <p>Exemple pour obtenir uniquement 1 valeur.</p> <p>Réglez le mode ASCII pour le canal 1 ou le canal 2.</p> <p>*SS1001 ou *SS2001</p> <p>Réglez l'échelle pour le canal 1 ou le canal 2.</p> <p>*SC1XX ou *SC2XX, où XX représente l'échelle que vous voulez en décimale.</p> <p>Réglez le mode de polarité.</p> <p>* VNM</p> <p>Commencez l'acquisition interne.</p> <p>*CA1 ou *CA2</p> <p>Demandez 1 valeur pour le canal 1 ou le canal 2.</p> <p>*CV1 ou *CV2</p>
*VNM	Activez le mode de polarité *VNP, ce mode est uniquement disponible en mode ASCII
*VNP	Désactivez les modes *CV1 et CV2 (modes par défaut lors de la mise sous tension)
*RG1 / *RG2	<p>Renvoie les échelles maximale et minimale actuelles pour le canal 1 ou 2.</p> <p>L'information est codée</p>

	<p>Les 5 premiers octets représentent l'identifiant</p> <p>00000 : échelle minimale.</p> <p>00001 : échelle maximale.</p> <p>10000 : Fin de la transmission.</p> <p>Les 4 derniers octets représentent l'échelle codée en valeur hexadécimale, utilisez le tableau d'échelle ci-dessous pour déterminer l'échelle</p> <p>Exemple</p> <p>Après RG1 vous recevrez la réponse</p> <p>« :000000013</p> <p>:00001001A</p> <p>100000000 »</p> <p>Ce que cela signifie</p> <p>:000000013 : est l'échelle minimale 13 hexadécimale = 19 = 3m</p> <p>:00001001A : est l'échelle maximale 1A hexadécimale =26=10 (watt ou joule)</p> <p>:100000000 : Fin de la transmission.</p>
*SO1 /	Réglez le décalage zéro du canal 1 ou 2.
*SO2	Cette commande soustrait la valeur actuelle de toutes les mesures futures au moment où la commande est émise en vue de définir un nouveau point zéro.
*CO1 /	Annuler le décalage zéro du canal 1 ou 2.
*CO2	Cette commande annule la commande de décalage du zéro et règle le point zéro à zéro.
*DO1 /	Affiche le décalage zéro du canal 1 ou au canal2.
*DO2	Cette commande affiche la valeur du décalage zéro.
*SC1xx /	Pour régler l'échelle au canal 1 ou au canal 2.
*SC2xx	<p>xx = voir le tableau ci-dessous, vous acheminez la valeur pour l'échelle en décimale, mais en faisant la demande d'état, le S-Link l'achemine en hexadécimale.</p> <p>Vous devez interrompre l'acquisition continue (*CS1, *CS2) avant d'envoyer cette commande.</p>

Échelle	xx	
1p	00	1 picowatt ou picojoule
3p	01	3 picowatts ou picojoules
10p	02	10 picowatts ou picojoules
30p	03	30 picowatts ou picojoules
100p	04	100 picowatts ou picojoules
300p	05	300 picowatts ou picojoules
1n	06	1 nanowatt ou nanojoule
3n	07	3 nanowatts ou nanojoules
10n	08	10 nanowatts ou nanojoules
30n	09	30 nanowatts ou nanojoules
100n	10	100 nanowatts ou nanojoules
300n	11	300 nanowatts ou nanojoules
1u	12	1 microwatt ou microjoule
3u	13	3 microwatts ou microjoules
10u	14	10 microwatts ou microjoules
30u	15	30 microwatts ou microjoules
100u	16	100 microwatts ou microjoules
300u	17	300 microwatts ou microjoules
1m	18	1 milliwatt ou millijoule
3m	19	3 milliwatts ou millijoules
10m	20	10 milliwatts ou millijoules
30m	21	30 milliwatts ou millijoules
100m	22	100 milliwatts ou millijoules
300m	23	300 milliwatts ou millijoules
1	24	1 watt ou joule
3	25	3 watts ou joules
10	26	10 watts ou joules
30	27	30 watts ou joules
100	28	100 watts ou joules
300	29	300 watts ou joules
1k	30	1 kilowatt ou kilojoule
3k	31	3 kilowatts ou kilojoules
10k	32	10 kilowatts ou kilojoules
30k	33	30 kilowatts ou kilojoules
100k	34	100 kilowatts ou kilojoules
300k	35	300 kilowatts ou kilojoules
1meg	36	1 mégawatt ou mégajoule
3meg	37	3 mégawatts ou mégajoules
10meg	38	10 mégawatts ou mégajoules
30meg	39	30 mégawatts ou mégajoules
100meg	40	100 mégawatts ou mégajoules
300meg	41	300 mégawatts ou mégajoules

Définitions des états

*ST1 : État pour le canal #1

*ST2 : État pour le canal #2

Tableau 1

Valeur hexadécimale	Adresse (premiers 5 octets)	4 derniers octets	Définition	dans cet exemple
:00000428	0000	0428	Longueur d'onde en valeur hexadécimale	1064
:000010013	00001	0013	Échelle courante en valeur hexadécimale	19= 3 mJ
:00002002B	00002	002B	Niveau de déclenchement en valeur hexadécimale/ 20,48	43/20,48= 2,1 %
:000030000	00003	0000	Réservé	
:000040000	00004	0000	Réglage de l'atténuateur 0000 = sans atténuateur 0001 = avec atténuateur	Sans atténuateur
:000050001	00005	00001	Réglage du déclencheur externe 0000 = désactivé 0001 = activé	Actif
:000060000	00006	0000	Anticipation 0000 = désactivé 0001 = activé	Désactivé
:000070000	00007	0000	Mode énergie pour la tête de puissance 0000 = désactivé 0001 = activé	Désactivé
:100000000	Fin du fichier	0000		

2 ENTRETIEN



2.1 Installation USB pour le S-Link

Le S-Link est doté d'un port USB de type B. Lorsqu'il est branché à un ordinateur, il agit comme avec un port de série standard. Il comporte une interface simple, il est donc facile de concevoir un logiciel pour celui-ci. Le S-Link ne peut fonctionner qu'avec une alimentation fournie par le biais du port USB.

2.2 Mise à niveau gratuite du logiciel

Mettez à jour votre logiciel S-Link à la plus récente version pour obtenir les nouvelles fonctions et options. Vous avez tout intérêt à obtenir les versions récentes et améliorées du micrologiciel du S-Link, dès qu'elles sont disponibles. Le plus récent micrologiciel peut être téléchargé du site web Gentec-EO.

La mise à jour doit être effectuée par le biais du port USB. Une mise à jour par le biais du port Ethernet rendra le S-Link inutilisable et il devra être reprogrammé par le fabricant.

Accédez à notre site Web www.gentec-eo.com. Allez à la section **Téléchargements**. Cliquez sur le nom du fichier d'instructions de mise à jour du S-Link pour ouvrir ou télécharger les instructions. Vous pouvez imprimer les instructions, au besoin. Repérez le fichier correspondant à votre S-Link dans la section Download (téléchargements), et suivez les directives, simples et conviviales.

3 Procédure d'installation de l'Ethernet

Branchez les têtes au S-Link, mettez le S-Link sous tension et connectez le S-Link à un réseau. Ne connectez pas de connecteur USB, car le S-Link passera en communication USB.

Les étapes suivantes sont si vous souhaitez utiliser la capacité du port COM virtuel du S-LINK-Ethernet. Cette méthode permet l'utilisation du logiciel de bureau PC-S-Link via la connexion Ethernet.

Pour vous connecter directement à S-Link-Ethernet via Telnet, utilisez le port 10001. Le logiciel CPR Manager et/ou DeviceInstaller mentionné dans les sections ci-dessous peut vous aider à trouver l'adresse IP de S-Link-Ethernet. Vous pouvez également utiliser ces programmes pour définir une adresse IP statique.


3.1 Installer ces fichiers à partir du CD

- CprDotNetDL4.1.0.2_Web.exe
- dotnetfx.exe (si le dotnetfx est déjà installé avec une version supérieure, sautez cette étape)


3.2 Créer un port Com

Exécutez **CPR Manager**.


Allez au menu **Device** (Réglage de l'appareil) et cliquez sur **Search** (Rechercher).

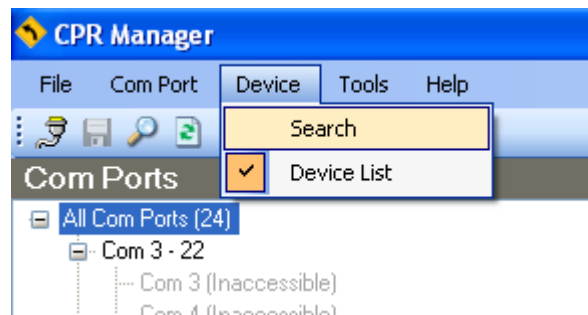

Allez au menu **Com Port** (Port Com) et sélectionnez **Add and Remove** (Ajouter ou supprimer).

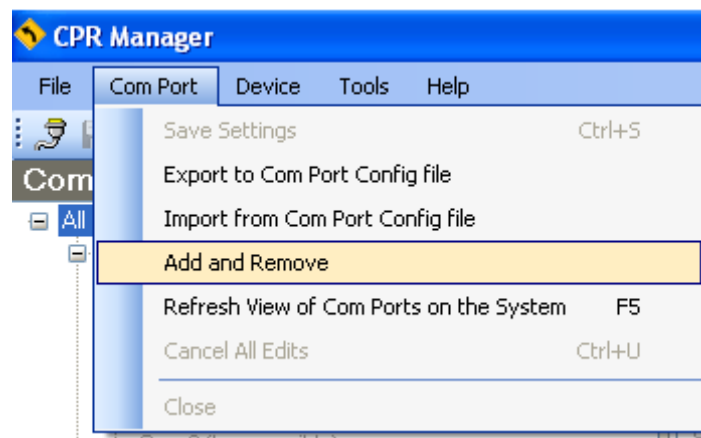

Sélectionnez un nouveau port Com et cliquez sur OK.

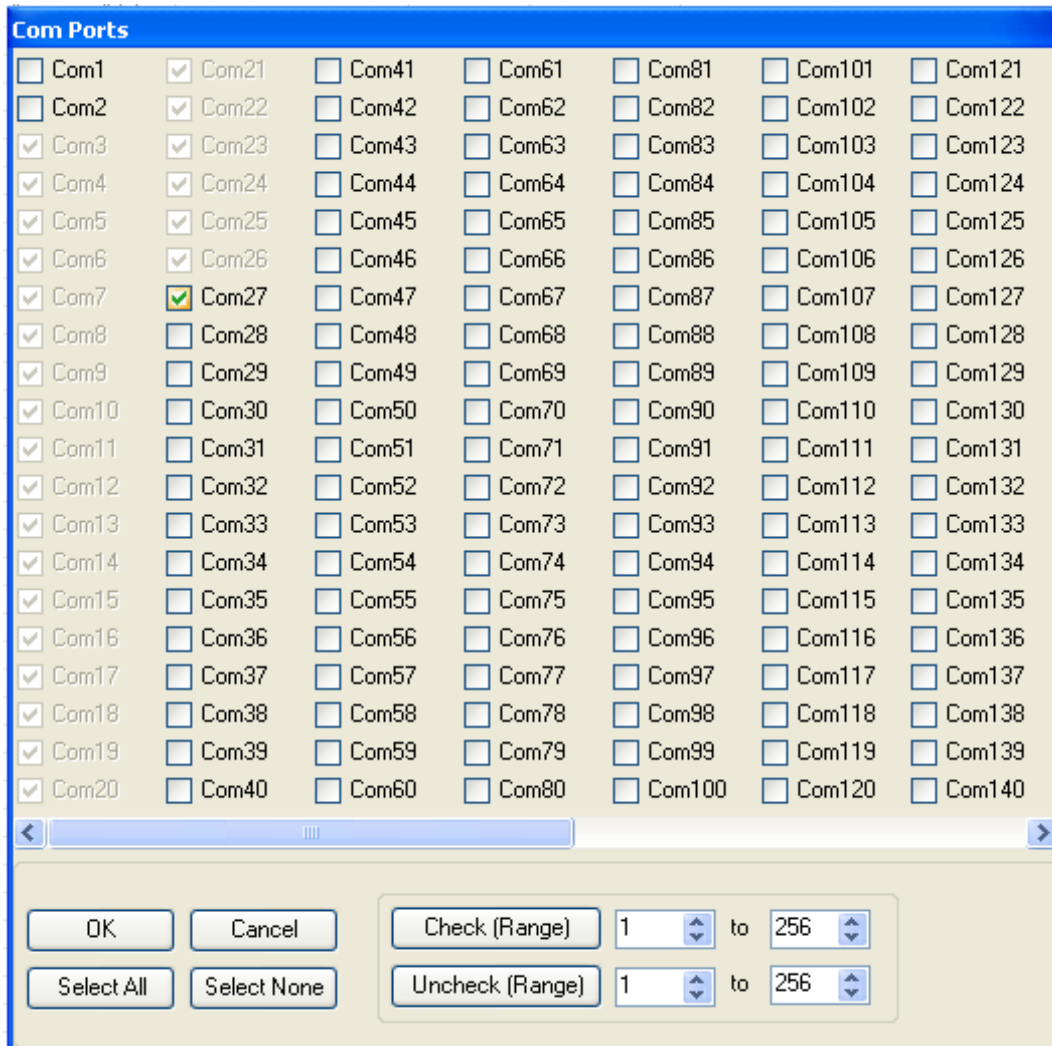

3.3 Acheminez l'adresse IP au port Com.

Étape 1 : Double-cliquez sur le nouveau port Com.

Étape 2 : Double-cliquez sur l'adresse IP. Sélectionnez « **Add Rx Port** » (Ajouter un port Rx) pour configurer la liste d'exclusion du pare-feu au besoin.

Étape 3 : Cliquez sur l'icône de disque bleu pour enregistrer les réglages. Cette action ajoutera un nouveau port Com sur votre ordinateur. Vous pouvez maintenant exécuter l'interface PC (S-Link) pour le connecter à votre S-Link.

Com Ports

- All Com Ports (25)
 - Com 3 - 22
 - Com 3 (Inaccessible)
 - Com 4 (Inaccessible)
 - Com 5 (Inaccessible)
 - Com 6 (Inaccessible)
 - Com 7 (Inaccessible)
 - Com 8 (Inaccessible)
 - Com 9 (Inaccessible)
 - Com 10 (Inaccessible)
 - Com 11 (Inaccessible)
 - Com 12 (Inaccessible)
 - Com 13 (Inaccessible)
 - Com 14 (Inaccessible)
 - Com 15 (Inaccessible)
 - Com 16 (Inaccessible)
 - Com 17 (Inaccessible)
 - Com 18 (Inaccessible)
 - Com 19 (Inaccessible)
 - Com 20 (Inaccessible)
 - Com 21 (Inaccessible)
 - Com 22 (Inaccessible)
 - Com 23 - 27
 - Com 23 (Inaccessible)
 - Com 24 (Inaccessible)
 - Com 25 (Inaccessible)
 - Com 26 (Inaccessible)
 - Com 27 (New)

Settings

Com 27 (New)

Window's Port Name: Com Status: Erro
 Window's Device Name: Network Status: Disc
 Window's Service Name:

Reset to Defaults Cancel Edits

Buffer Writes (Keep checked for better write performance)
 Server Reconnect
 No Net Close

7 Connection Tim
 Timeout Reconnect

Listen Mode Normal - port closed after disconnect TCP Po

TCP KeepAlive 7200000 KeepAlive Time (msec) 1000 KeepAlive I

RFC 2217 (TruPort) DTR (In): Tie DTR to DCD, DSR always active
 Tx Empty: CPR Transmit Buffer Empty

Service	Host	TCP Port
1	192.168.1.14	10001
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

WARNING! If the Host is on the other then UDP ports 30718, 43282 and 4321 firewall's exclusion list. You may exper these UDP ports are not excluded.

Also, some legacy device servers resp unable to connect to a device server, c this machine is blocking this port. Pres port to the Firewall. If the button capt port has already been added and can b

Add Rx Port

Devices

IP Address	TCP Port	Device Name	Port Name	HW Address	ID	Product
192.168.1.14 (1)	10001			00:20:4A:97:6A:D9	X8	Unknown (X8)

3.4 Configurer une connexion réseau directe entre un ordinateur à environnement Windows et un S-Link

Pour les applications portatives ou une application sur table où votre S-Link n'a pas besoin d'être câblé à un réseau plus vaste, vous pouvez connecter directement votre ordinateur au S-Link en utilisant un **câble réseau croisé**. Ce type spécial de câble élimine le besoin d'un concentrateur réseau. Comme solution de rechange, vous pouvez utiliser des câbles réguliers et une petite boîte de concentrateur réseau.

Vous avez besoin d'un câble Ethernet 10baseT croisé (paire torsadée/câble UTP). Généralement, la couleur du câble est orange ou rouge.

Vous devez configurer vos réglages de réseau.

3.4.1 Configurer le protocole TCP-IP sur votre ordinateur.

Ouvrez le panneau de configuration dans Windows (**Start/Settings/ControlPanel**) (Démarrer/Réglages/Panneau de configuration) et double-cliquez sur l'icône de réseau.

Si vous avez déjà installé le TCP-IP, vous n'avez qu'à double-cliquer sur celui-ci.


Pour installer le TCP-IP, appuyez sur le bouton « Add » (Ajouter), sélectionnez « protocol » (protocole), « Microsoft » et « TCP/IP ».

Entrez l'adresse IP de votre ordinateur. Puisque c'est un réseau privé, vous pouvez utiliser 192.168.0.1.


Entrez le masque de sous-réseau. Utilisez 255.255.255.0.

Il n'est pas nécessaire de configurer de serveur « gateway » (passerelle) ou « DNS » puisque vous ne vous connecterez pas à d'autres réseaux.


Allez à **Network Connections** (Connexions réseau).

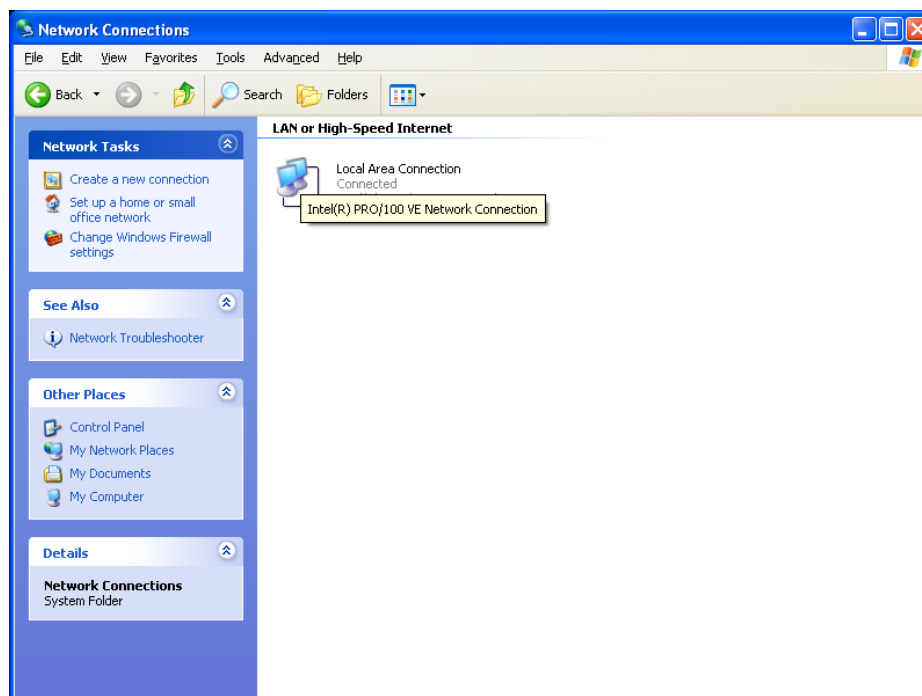

Allez à **Properties** (Propriétés).

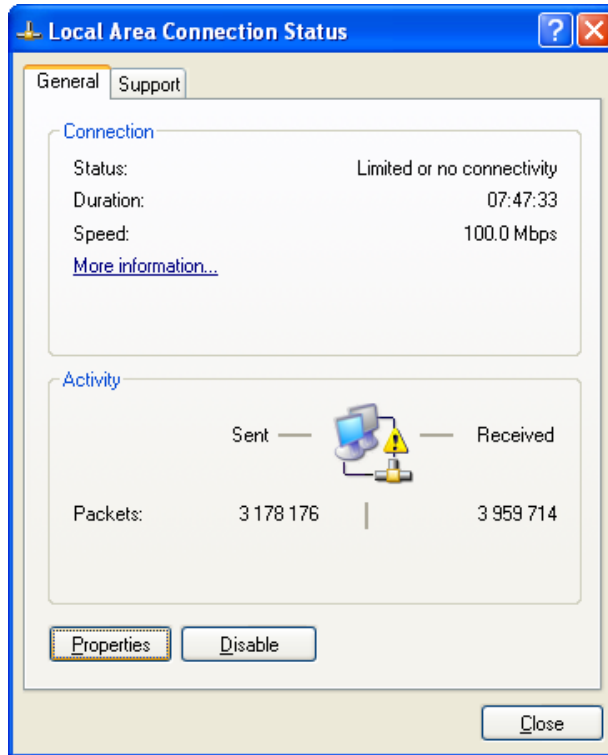


Allez à **TCP-IP Properties** (Propriétés TCP-IP).

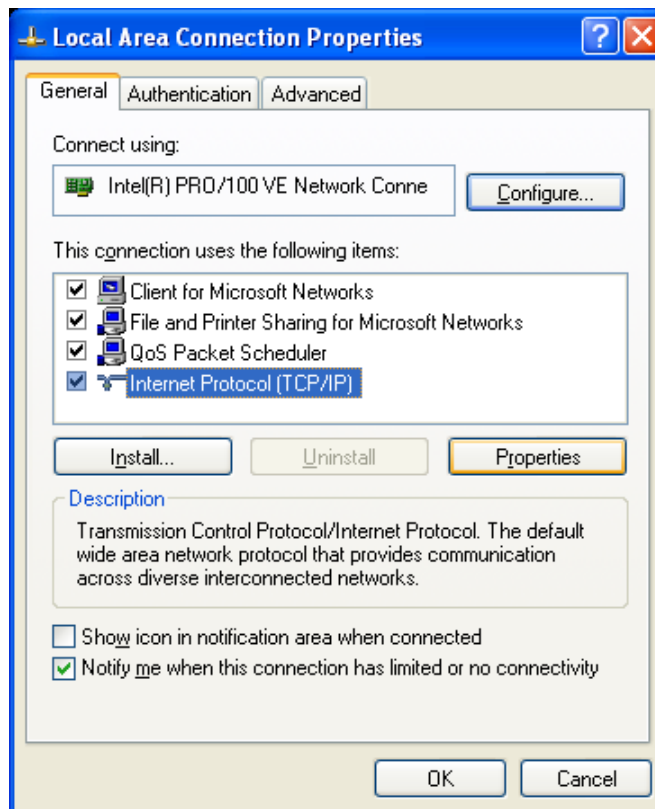

Sélectionnez « **Use the Following IP Address** » (Utilisez l'adresse IP suivante).

Entrez les chiffres suivants :

- IP : 192.168.0.1
- Masque : 255.255.255.0

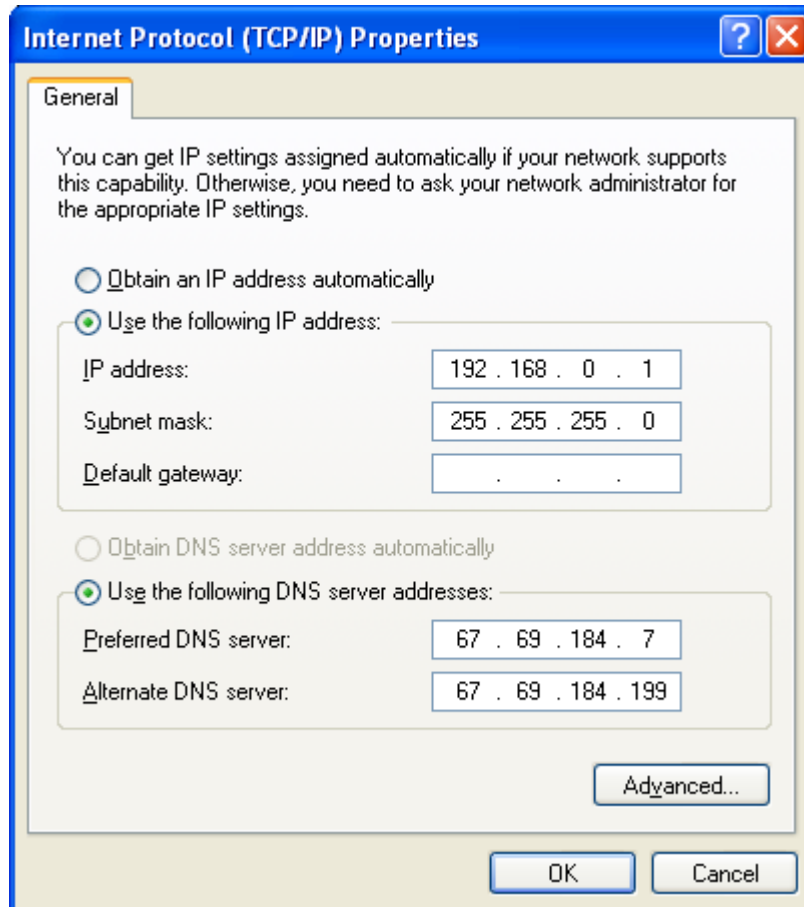


3.4.2 Configurer l'adresse IP dans S-Link

Nous recommandons de modifier le réglage S-Link (l'adresse IP) seulement lorsque vous voulez créer un réseau direct. Ne configurez pas l'adresse IP dans le S-Link sur un réseau sauf si vous êtes certain que l'adresse IP est disponible. Demandez à votre gestionnaire de réseau de réserver une adresse IP pour vous si vous ne voulez pas réassigner l'adresse IP au port Com chaque fois que le S-Link demande une adresse IP dans les réglages IP dynamiques.


Installez le fichier DI_4.2.0.0_Web à partir du CD.

Exécutez le programme "DeviceInstaller" de Lantronix.

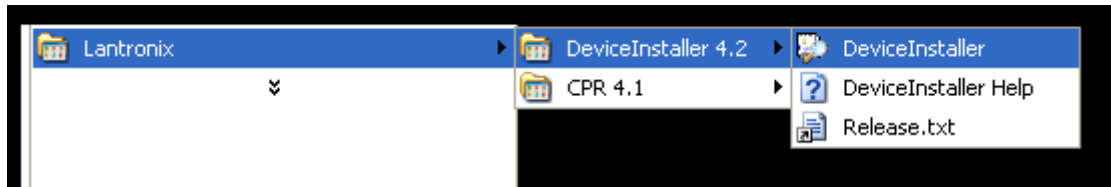


Sélectionnez le micrologiciel "Xport direct+" et cliquez sur l'adresse IP disponible.

Sélectionnez l'onglet **Web Configuration** (Configuration Web). Cliquez sur GO.

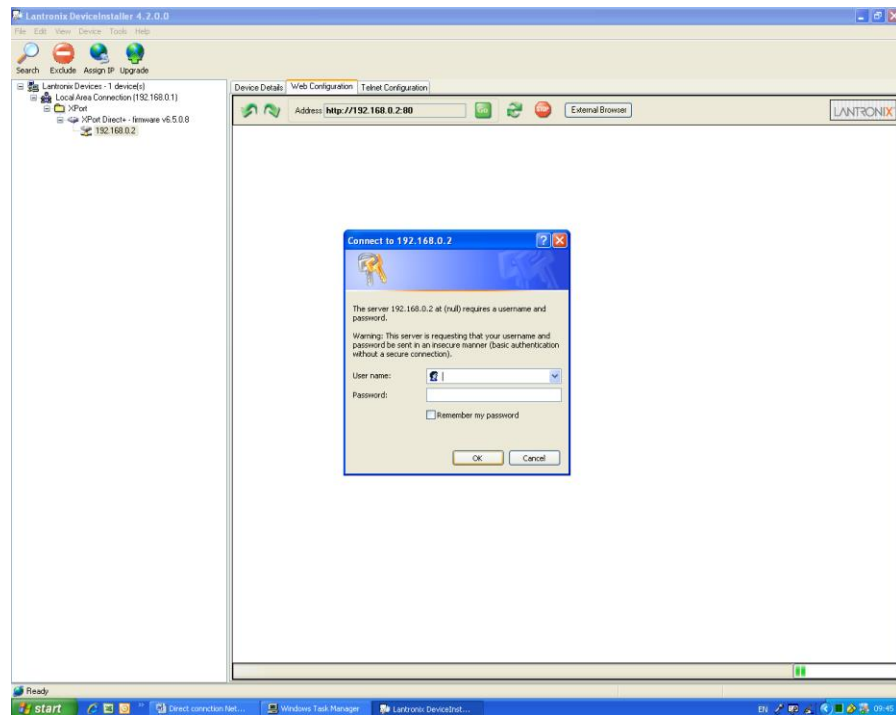

Cliquez sur OK pour **Username** (nom d'utilisateur) et **Password** (mot de passe) (laissez-les vides).

Sélectionnez l'option « **Network** » (Réseau) et ne modifiez aucun autre réglage.

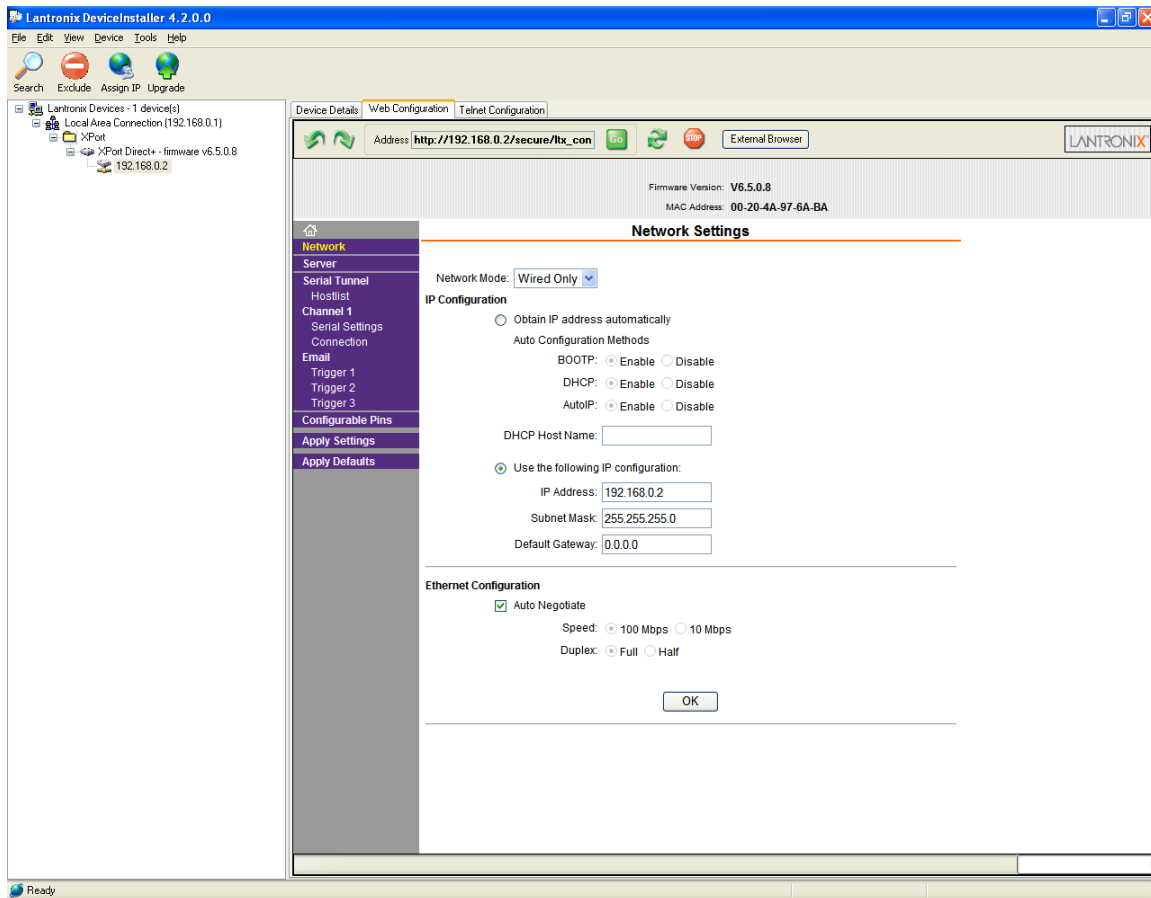


Cliquez sur « **Use the following IP configuration** » (Utiliser la configuration IP suivante).

Configurez l'adresse IP à : 192.168.0.2

Configurez le masque de sous-réseau à : 255.255.255.0

Cliquez sur OK puis cliquez sur **Apply Settings** (appliquer les réglages).


Le S-Link se redémarrera automatiquement. Puisque l'adresse IP a été modifiée, la configuration Web perdra sa connexion. Fermez l'installateur d'appareil si la configuration Web continue d'essayer de se connecter. Pour tester votre configuration, vous pouvez ouvrir le navigateur à 192.168.0.2. Vous devriez voir la fenêtre de connexion. Allez à la section 6.2 pour créer un PORT COM. Si vous désirez changer l'adresse IP à nouveau ou la configurer pour obtenir une adresse IP automatiquement, vous devrez utiliser une connexion réseau directe à nouveau.

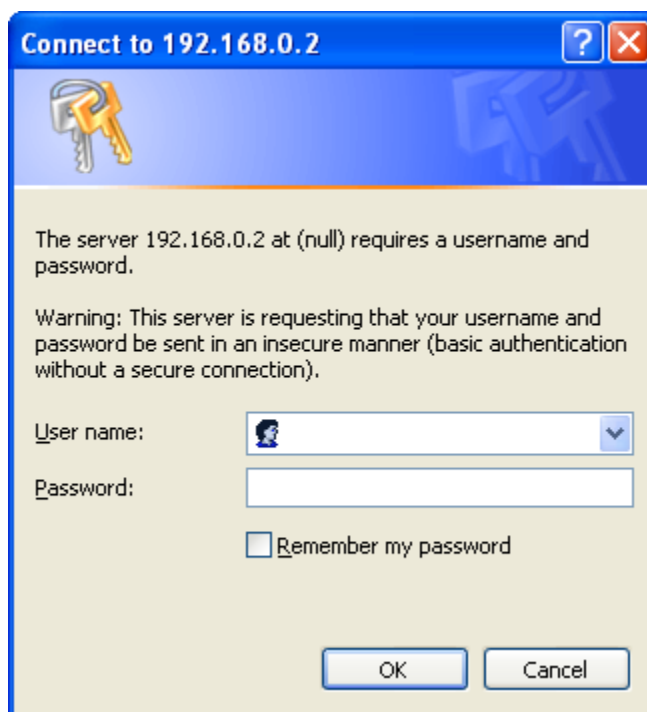

3.4.3 Régler les valeurs par défaut de l'Ethernet dans le S-Link


Le PC-S-Link utilise un circuit Ethernet à haut rendement et communique à 921 600 bps. Si vous modifiez cette valeur, vous devez la configurer à nouveau.

Chargez l'installateur d'appareil de Lantronix.

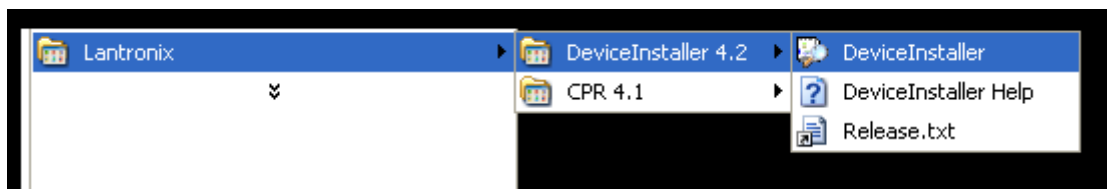

Sélectionnez l'adresse IP du micrologiciel The **Xport direct+**.

Sélectionnez l'onglet **Web Configuration** (Configuration Web). Cliquez sur **GO**.

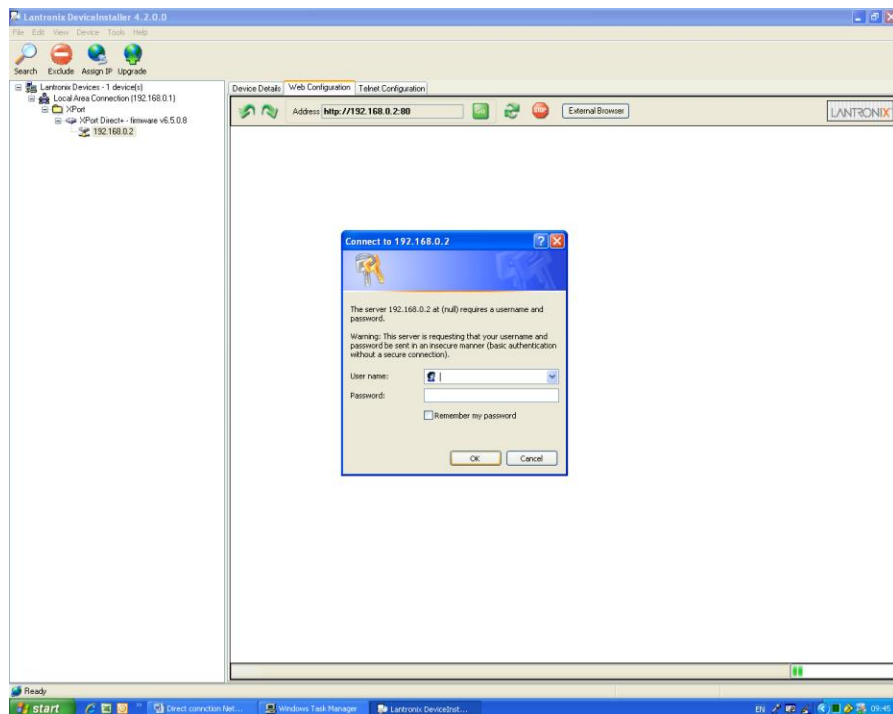

Cliquez sur **OK** pour **Username** (nom d'utilisateur) et **Password** (mot de passe) (laissez-les vides).

Sélectionnez l'option « **Server** » (serveur), réglez le **CPU Performance Mode** à **High**, puis cliquez sur OK.

Firmware Version: V6.5.0.8
MAC Address: 00-20-4A-97-6A-BA

Server Settings

Network

Server

Serial Tunnel

Hostlist

Channel 1

Serial Settings

Connection

Email

Trigger 1

Trigger 2

Trigger 3

Configurable Pins

Apply Settings

Apply Defaults

Server Configuration

Telnet Password:

Retype Password:

Advanced

ARP Cache Timeout (secs):

TCP Keepalive (secs):

Monitor Mode @ Bootup: Enable Disable

CPU Performance Mode: Low Regular High

HTTP Server Port:

Config Server Port:

MTU Size:

4 Dépannage

Message !TRIG : Le taux de répétition de votre laser est trop élevé pour la capacité de votre ordinateur, ou vous déclenchez sur le bruit. Réglez le déclencheur à un niveau plus élevé ou mettez à jour votre ordinateur.

L'application ne répond pas lorsque je sélectionne Status (état) ou lorsque je veux changer les réglages **Graphic** (graphique). Appuyez sur la touche ALT, votre fenêtre d'état est peut-être derrière l'application PC S-Link. Cela se produit lorsque vous établissez un marqueur temporel du graphique à une valeur trop élevée pour certains ordinateurs.

Impossible de se connecter au port Ethernet.

- 1) Redémarrez l'ordinateur lorsque vous modifiez l'adresse IP si vous avez une connexion directe.
- 2) Une des causes possibles est que le pare-feu de l'ordinateur bloque ce port. Appuyez sur le bouton « Add Rx Port » (Ajouter un port Rx) pour ajouter ce port au pare-feu. Si la légende du bouton indique « Remove Rx Port » (Supprimer un port Rx), cela signifie que le port a déjà été ajouté et qu'il peut être supprimé en appuyant sur ce bouton.
- 3) Désactivez votre pare-feu local.
- 4) Lisez la foire aux questions de Lantronix.

http://ltxfaq.custhelp.com/cgi-bin/ltxfaq.cfg/php/enduser/std_alp.php

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Application des directives du Conseil : 2004/108/EC Directive CEM

Nom du fabricant : Gentec Electro-Optics, Inc.
 Adresse du fabricant : 445, St-Jean-Baptiste, bureau 160
 (Québec) Canada G2E 5N7

Nom du représentant en Europe : Laser Component S.A.S
 Adresse du représentant : 45 bis Route des Gardes
 92190 Meudon (France)

Type d'équipement : Wattmètre/joulemètre laser
 Numéro du modèle : S-Link
 Année d'essai et de fabrication : 2011

Normes auxquelles la conformité est déclarée :
 EN 61326-1 : Norme générique d'émission 2006

Norme	Description	Critères de performance
CISPR 11:2009 A1:2010	Appareils industriels, scientifiques et médicaux – Caractéristiques des perturbations radioélectriques – Limites et méthodes de mesure	Classe A
EN 61000-4-2 2009	Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-2 : Techniques d'essai et de mesure - Décharges électrostatiques.	Classe B
EN61000-4-3 2006+A2:2010	Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-3 : Techniques d'essai et de mesure - Essai d'immunité aux champs électromagnétiques rayonnés aux fréquences radioélectriques.	Classe A
EN61000-4-4 2004+A1:2012	Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-4 : Techniques d'essai et de mesure - Essais d'immunité aux impulsions rapides électriques répétitives.	Classe B
EN 61000-4-5 2006	Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-5 : Techniques de test et de mesure - Test d'immunité aux surtensions.	Classe B
EN 61000-4-6 2013	Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-6 : Techniques d'essai et de mesure - Immunité aux perturbations conduites, induites par les champs radioélectriques.	Classe A
EN 61000-4-11 2004	Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-11 : Techniques de test et de mesure - Test d'immunité aux chutes de tension, aux courtes interruptions et aux variations de tension	Classe B Classe B Classe C Classe C
EN 61000-3-2:2006 +A1:2009	Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 3-2 : Limites - Limites pour les émissions de courant harmonique (courant appelé par les appareils inférieur ou égal à 16 A par phase)	Classe A

Je, soussigné, déclare que l'équipement indiqué ci-dessus est conforme aux Directives et aux Normes susmentionnées.

Lieu : Québec (Québec)

Date : 4 mai 2011

(président)

5 Annexe A

5.1 Procédure d'étalonnage de l'atténuateur/diffuseur

Introduction :

Ces « Atténuateurs/Diffuseurs » doivent être étalonnés par l'**utilisateur** pour les longueurs d'ondes autres la longueur d'ondes étalonnée (généralement 1,064 μm).

La procédure d'étalonnage est relativement facile. Mesurer en premier sans l'atténuateur, puis avec l'atténuateur. Le rapport de ces mesures sera votre correction.

Lors de l'utilisation d'un oscilloscope :

Divisez la tension de sortie du joulemètre par la sensibilité d'étalonnage que nous avons fournie pour calculer la lecture de l'énergie (voir le guide du joulemètre).

*Pour utiliser cette procédure à une longueur d'onde autre que celle mentionnée sur le certificat d'étalonnage, réglez manuellement la valeur de sensibilité (du certificat d'étalonnage) par le **multiplicateur de correction** de longueur d'ondes inscrit sur le certificat de correction de longueur d'ondes. Utilisez cette sensibilité de longueur d'onde ajustée pour calculer les lectures d'énergie utilisées dans la procédure qui suit.*

En utilisant un S-Link de Gentec-EO :

Dans le menu **Control**, il ne devrait **pas y avoir de crochet** dans le réglage de l'**Atténuateur**. Il devrait être désactivé afin de pouvoir accéder à la correction de longueur d'ondes (**Réglages** → **menu Corrections**). Vous devez faire cela afin de pouvoir entrer la longueur d'onde à laquelle vous étalonnez (voir le guide du moniteur). Le réglage de l'**Atténuateur** devrait décocher, si vous refaites un étalonnage à la même longueur d'ondes que celle mentionnée sur le certificat d'étalonnage du joulemètre.

Procédure :

Étape 1 : Paramétrez votre joulemètre pour mesurer l'énergie de votre laser pulsé. Si vous travaillez à une longueur d'onde autre que celle de la longueur d'onde étalonnée, ajustez la sensibilité de votre joulemètre en fonction de cette longueur d'onde, voir **Lors de l'utilisation d'un oscilloscope ou Lors de l'utilisation d'un S-Link de Gentec-EO**, ci-dessus. Assurez-vous que le niveau d'énergie se situe en dessous du seuil de dommage du détecteur, et que votre laser soit encore stable.

Étape 2 : Appliquez l'énergie durant quelques minutes pour réchauffer le détecteur. Ceci réduira le risque de variation thermique.

Étape 3 : Mesurez le niveau d'énergie sans l'atténuateur. Pour réduire les facteurs d'incertitude aléatoire, prenez la moyenne d'un nombre donné de lectures uniques. Nous recommandons de prendre au moins cent lectures uniques. Ceci devrait réduire le risque d'erreurs aléatoires par un facteur de 10. (Racine carrée de « n » dans l'hypothèse d'une distribution gaussienne)

Étape 4 : Installez l'atténuateur. Sans changer les réglages du laser, mesurez le niveau d'énergie, en prenant la moyenne du même nombre de lectures uniques. Tous les réglages du laser doivent être identiques à l'étape 3 (incluant la taille du faisceau et la position sur le détecteur).

Étape 5 : Répétez la première mesure (étape 3), afin de vous assurer que rien n'a changé durant la procédure qui aurait invalidé l'étalonnage. Un changement plus important que celui de l'incertitude de vos mesures signifie que quelque chose a changé dans le laser ou dans l'environnement. Ajoutez ceci à votre \pm incertitude lorsque vous utilisez l'atténuateur ou essayez de stabiliser le laser et l'environnement. Revenez à l'étape 3.

Le multiplicateur de correction pour le S-Link et un oscilloscope sont calculés.

$$T_f = \frac{\text{Reading without attenuator}}{\text{Reading with attenuator}} \quad (\text{Aucune unité})$$

Utilisez ce facteur d'étalonnage pour l'« Atténuateur/Diffuseur » à la longueur d'ondes établie à l'étape 1.

6 Annexe B

6.1 Procédure de recyclage et de tri.

Cette section est utilisée par le centre de recyclage lorsque le moniteur atteint la fin de sa vie utile. Le bris du sceau d'étalonnage ou l'ouverture du moniteur annulera la garantie du S-Link.

Le moniteur complet contient :

- moniteur;
- câble USB ;
- 1 guide d'utilisation;
- 1 certificat d'étalonnage;
- 1 logiciel sur CD-ROM.

L'option Ethernet contient :

- 1 bloc d'alimentation (à commander séparément) (pas fabriqué par Gentec-EO);
- câbles Ethernet.

6.2 Tri :

Papier : guide et certificat.

Aluminium : boîtier du moniteur.

Carte de circuit imprimé : à l'intérieur du moniteur.

6.3 Procédure de démontage :

Pour ouvrir le moniteur :

Retirez toutes les vis des deux côtés du moniteur :

Retirez la carte de circuit imprimé en la faisant glisser du boîtier.

7 Annexe C

7.1 Procédure pour réparer le port com

Cette procédure sert à éviter que le port COM s'incrémente continuellement en fonction de nouveaux dispositifs. Veuillez noter que le port COM changera, si vous branchez le câble USB à un nouvel emplacement sur votre ordinateur, mais il n'incrémentera pas avec un autre S-Link-2 dans le même port USB.

Procédure :


Branchez uniquement 1 dispositif à la fois.

Démarrez le programme FT_PROG.exe.


Pour faire fonctionner l'application FT_PROG.

1. Installez les pilotes USB qui se trouvent sur le site Web de Gentec-EO.
<http://www.gentec-eo.com/en/downloads.htm>
2. Téléchargez la plus récente version de FT_PROG à partir de la section Utilities du site Web FTDI.
<http://www.ftdichip.com/Resources/Utilities.htm>
3. Décompressez tous les fichiers à partir du dossier .zip que vous avez téléchargé.
4. Pour fonctionner, FT_PROG requiert que Microsoft .NET Framework 2.0 soit installé sur votre ordinateur. Il peut être obtenu à partir du site Web de Microsoft :
<http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=0856EACB-4362-4B0D-8EDD-AAB15C5E04F5&displaylang=en>
Téléchargez-le et suivez l'assistant pour installer .NET 2.0 s'il n'est pas déjà installé sur votre ordinateur.
5. Pour exécuter l'application, double cliquez sur l'icône FT_PROG.exe.


Étape 1 : Cliquez sur **Scan and Parse** dans **Devices**.

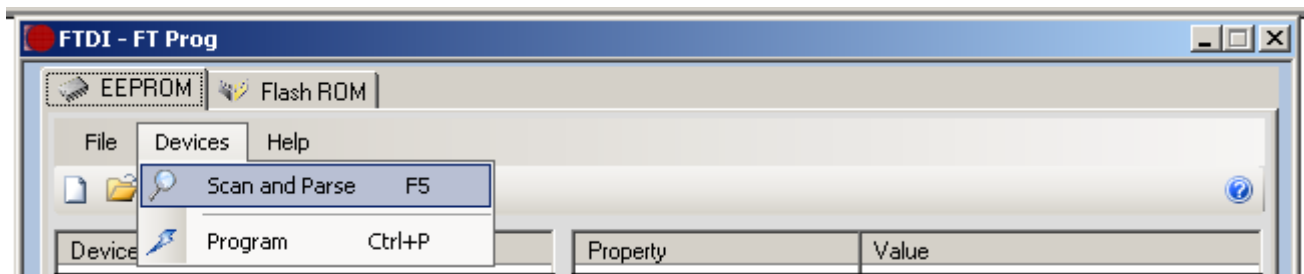


Étape 2 : Désélectionnez le Serial USB UART qui se trouve dans **USB_String_Descriptor**.

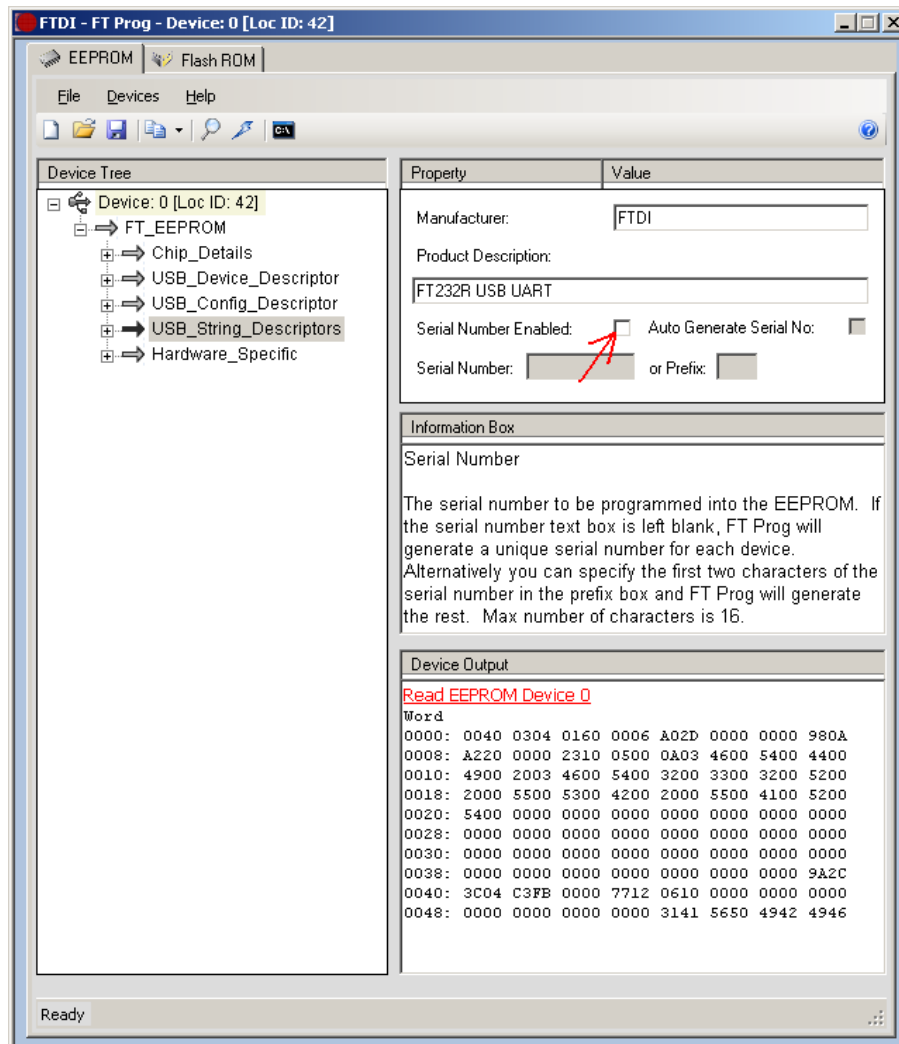

Étape 3 : Sélectionnez **Program** (Programmer) dans **Devices** (Onglet).

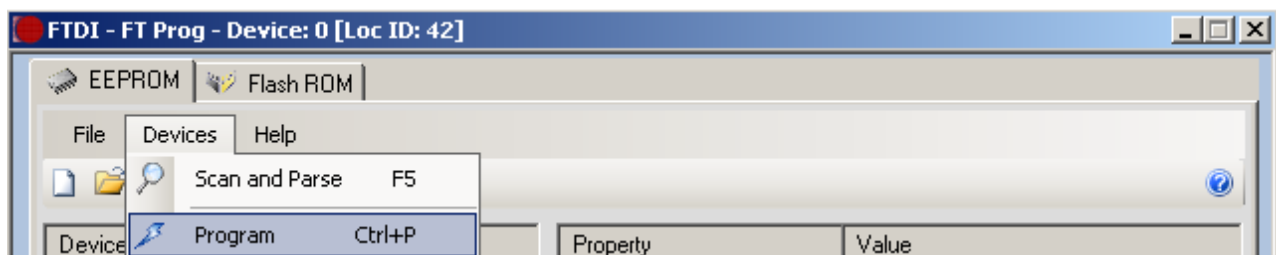

Étape 4 : Sélectionnez le dispositif dans la liste **Device** (Onglet), cliquez sur **Program** (Programmer) et fermez le logiciel FT_PROG. Débranchez et rebranchez le dispositif USB.

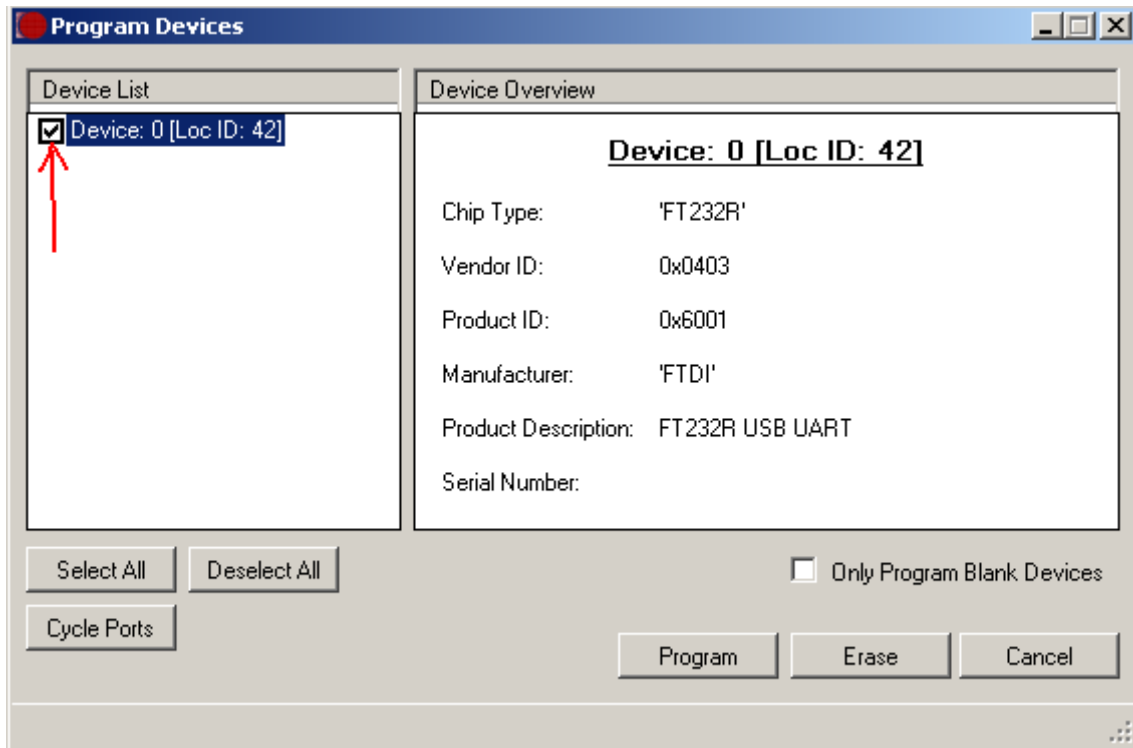

8 Annexe D

8.1 S-LINK-2 DESCRIPTION DU MODE BINAIRE

8.1.1 DESCRIPTION

Le S-LINK-2 comporte deux modes de communication : le mode binaire pour l'acquisition de données RAPIDE, et le mode ASCII pour les valeurs lentes de haute résolution. La résolution du mode wattmètre est 11 bits, la résolution du mode joulemètre est 12 bits. La résolution en mode ASCII est 15 bits.

La valeur en mode binaire est codée en deux octets.

MODE JOULEMÈTRE

Octet 1

C	O	2	X	X	X	X	X
---	---	---	---	---	---	---	---

Octet 2

C	O	X	X	X	X	X	X
---	---	---	---	---	---	---	---

2 = Le bit le plus significatif (MSB) de la codification à 12 bits pour le mode joulemètre.

X = Bits pour la codification.

MODE WATTMÈTRE

Octet 1

C	O	2	Y	X	X	X	X
---	---	---	---	---	---	---	---

Octet 2

C	O	X	X	X	X	X	X
---	---	---	---	---	---	---	---

2 = Le signe.

Y = Le MSB pour le mode wattmètre.

X = Bits pour la codification.

POUR TOUS LES MODES

C = Numéro du canal

0 = Canal 1

1 = Canal 2

O = Ordre

1 = Premier octet

0 = Second octet

8.1.2 CODIFICATION

MODE JOULEMÈTRE

En mode joulemètre, la codification n'a pas de polarité. Pour obtenir la mesure en joules, utilisez cette formule :

$$\text{Mesure en joule} = \text{échelle actuelle} * \text{codification en décimale} / 4096$$

Exemple : Pour 151 mJ sur 300 mJ échelle sur canal 1

Le S-LINK répondra : 600D HEX VALUE, ce qui signifie :

60 = 01100000

Le premier bit (0) est pour le canal 1

Le second bit (1) est l'ordre du bit le plus significatif (MSB).

100000 est le MSB de la codification

0D = 00001101

Le premier bit (0) est pour le canal 1

Le second bit (0) représente l'ordre, il s'agit donc du bit le moins significatif (LSB) de la codification

La codification totale est 100000001101, ce qui représente 2 061 en décimal ($2\,061 / 4\,096 * 300\text{mJ} = 151,952\text{ mJ}$)

MODE WATTMÈTRE

En mode wattmètre, la codification est polarisée, le troisième bit est ainsi le premier bit du signe. Pour obtenir la mesure en watts, utilisez cette formule :

$$\text{Mesure en watt} = \text{échelle actuelle} * \text{valeur en décimale} / 2\,048$$

Exemple 1 : Pour 151 mW sur l'échelle de 300 mW sur le canal 1

Le S-LINK répondra : 5006 HEX VALUE, ce qui signifie :

50 = 01010000

Le premier bit (0) est pour le canal 1

Le second bit (1) est l'ordre du bit le plus significatif (MSB).

Le troisième bit représente le signe

10000 est le MSB de la codification

06 = 00000110

Le premier bit (0) est pour le canal 1

Le second bit (0) représente l'ordre, il s'agit donc du bit le moins significatif (LSB) de la codification

La codification totale est 10000000110, ce qui représente 1 030 en décimal ($1\,030 / 2\,048 * 300\text{ mJ} = 151,878\text{ mJ}$)

Exemple 2 : Pour -151 mW sur l'échelle de 300 mW du canal 1

Le S-LINK répondra : 7006 HEX VALUE, ce qui signifie :

70 = 01110000

Le premier bit (0) est pour le canal 1

Le second bit (1) est l'ordre du bit le plus significatif (MSB).

Le troisième bit représente le signe

10000 est le MSB de la codification

06 = 00000110

Le premier bit (0) est pour le canal 1

Le second bit (0) représente l'ordre, il s'agit donc du bit le moins significatif (LSB) de la codification

La codification totale est -10000000110, ce qui représente -1 030 en décimal ($-1\,030 / 2\,048 * 300\text{ mW} = -150,878\text{ mW}$)

CHEF DE FILE EN MESURE LASER DEPUIS 1972



■ PUISSANCE ET ÉNERGIE LASER



■ PROFILOMÉTRIE LASER



■ MESUREURS THZ

CANADA

445 St-Jean-Baptiste, Suite 160
Quebec, QC, G2E 5N7
CANADA

T (418) 651-8003
F (418) 651-1174

info@gentec-eo.com

ÉTATS-UNIS

5825 Jean Road Center
Lake Oswego, OR, 97035
USA

T (503) 697-1870
F (503) 697-0633

info@gentec-eo.com

JAPON

Office No. 101, EXL111 building,
Takinogawa, Kita-ku, Tokyo
114-0023, JAPAN

T +81-3-5972-1290
F +81-3-5972-1291

info@gentec-eo.com

CENTRES DE CALIBRATION

- 445 St-Jean-Baptiste, Suite 160
Quebec, QC, G2E 5N7, CANADA
- Werner von Siemens Str. 15
82140 Olching, GERMANY
- Office No. 101, EXL111 building,
Takinogawa, Kita-ku, Tokyo
114-0023, JAPAN